

Tecnica chirurgica


balanSys BICONDYLAR

LIS 4in1

Strumenti SMarT

Uso riservato agli operatori sanitari. L'immagine riportata non rappresenta una correlazione tra l'uso del dispositivo medico descritto e la sua performance.

Preservation in motion

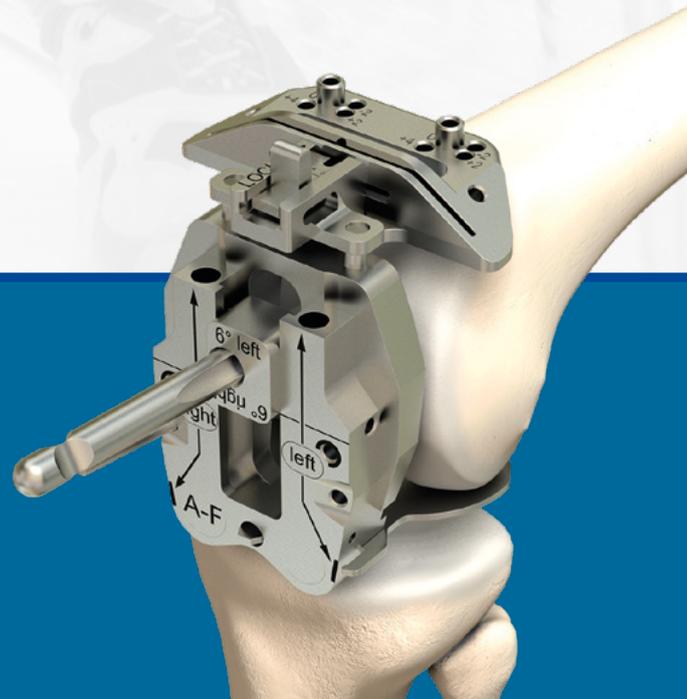

*Sulla base della nostra tradizione
Al passo con il progresso tecnologico
Passo per passo insieme ai nostri partner clinici
Per preservare la mobilità*

Preservation in motion

Come società svizzera, Mathys si impegna a seguire questo principio guida, realizzando una gamma di prodotti con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente, in termini di materiali o design, le filosofie tradizionali, per soddisfare le attuali esigenze cliniche. Tutto ciò si rispecchia nella nostra immagine: attività svizzere tradizionali in combinazione con attrezzature sportive in continua evoluzione.

Indice

Introduzione	4
Indicazioni e controindicazioni	5
Pianificazione preoperatoria	6
Scopo dell'intervento e accesso chirurgico	7
Preparazione del paziente	7
Panoramica sulla tecnica chirurgica	8
Tecnica chirurgica	10
1. Osteotomia femorale	10
2. Osteotomia tibiale	18
3. Preparazione e impianto	22
3.1 balanSys CR, UC e RP	22
3.2 balanSys PS	27
Allegato	33
1 – Osteotomia tibiale con allineamento intramidollare	33
2 – Rotula balanSys 3 perni	35
3 – Codici articolo degli impianti balanSys	38
4 – Compatibilità delle misure degli impianti balanSys	50
5 – Codici articolo degli strumenti balanSys	51
6 – Codici articolo dei lucidi radiografici balanSys	80
Simboli e abbreviazioni	81

Osservazione

Prima di utilizzare un impianto prodotto da Mathys Ltd Bettlach, si prega di familiarizzare con l'applicazione degli strumenti e con la tecnica chirurgica legata al prodotto nonché con gli avvertimenti, le note di sicurezza e le raccomandazioni del foglio d'istruzioni. Seguite i corsi di formazione offerti da Mathys e procedete secondo la tecnica chirurgica raccomandata.

Introduzione

Il sistema balanSys BICONDYLAR è un sistema modulare di protesi del ginocchio.

Ciascun sistema balanSys BICONDYLAR consiste in un componente femorale cementato o non cementato, un piatto tibiale cementato simmetrico e un inserto tibiale. Come opzione, è disponibile anche un componente patellare cementato. Per i componenti metallici femorali e tibiali, è disponibile una versione rivestita in TiNbN. La gamma degli inserti tibiali comprende una configurazione a supporto mobile (Rotating Platform (RP)) e tre differenti configurazioni a supporto fisso (Cruciate Retaining (CR), Ultra-Congruent (UC) e Posterior Stabilized (PS)).

Per gli inserti tibiali, è possibile scegliere tra due materiali: UHMWPE standard oppure vitamys, il PE stabilizzato con vitamina E, che presenta un'elevata resistenza all'usura ed è protetto dall'ossidazione.¹

Dal 1997, il sistema balanSys BICONDYLAR si è dimostrato clinicamente efficace, raggiungendo buoni risultati clinici.² Con il sistema di ginocchio balanSys, Mathys Ltd Bettlach offre un'ampia gamma di componenti che corrispondono alle caratteristiche anatomiche del paziente e ai requisiti funzionali del ginocchio.

Gli impianti, gli strumenti e le tecniche chirurgiche balanSys sono concepiti in modo da soddisfare le esigenze dei chirurghi in materia di protesi e riguardanti la cinematica, l'equilibrio legamentoso, la stabilità e la sopravvivenza a lungo termine.²

I preziosi strumenti e impianti sono destinati a eccellenti e costanti risultati clinici. Qualità svizzera.

¹ Data on file Mathys Ltd Bettlach.

² Superior long-term survival for fixed bearing compared with mobile bearing in ligament-balanced total knee arthroplasty. Heesterbeek, P.J.C., van Houten, A.H., Klenk, J.S. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, online 07 April 2017.

Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni

- Malattie articolari del ginocchio accompagnate da dolore e/o disabilità dovute a osteoartrosi, necrosi avascolare, artrite infiammatoria o artrosi post-traumatica
- Revisione di precedente sostituzione dell'articolazione del ginocchio

Controindicazioni

- Infezione locale o generalizzata
- Qualsiasi insufficienza dei tessuti molli, dei legamenti, dei nervi o dei vasi sanguigni che può comportare un rischio inaccettabile di instabilità della protesi, mancato fissaggio della protesi e/o complicanze nel decorso postoperatorio
- Compromissione della massa ossea dovuta a perdita ossea o difetti ossei e/o sostanza ossea insufficiente che non fornisce un supporto e/o fissaggio adeguato alla protesi
- Ipersensibilità ai materiali usati
- Immaturità scheletrica
- Ginocchio recurvato
- Insufficienza dell'apparato estensore
- Neoplasia progressiva

Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni per l'uso o rivolgersi al proprio rappresentante Mathys.

Pianificazione preoperatoria

Obiettivi della pianificazione preoperatoria

- Riconoscimento e quantificazione delle deformità e dei difetti ossei, nonché degli osteofiti
- Determinazione dell'angolo tra asse anatomico e asse meccanico
- Determinazione provvisoria della misura della protesi femorale e tibiale con l'ausilio dei lucidi di pianificazione

La pianificazione preoperatoria comprende

- Radiografie del ginocchio in proiezione antero-posteriore (ap) e laterale, e tangenziale della rotula
- Radiografia di tutto l'arto
- Lucido di pianificazione di tutto l'arto
- Lucido radiografico

Scopo dell'intervento e accesso chirurgico

- Correzione intraoperatoria di divergenze assiali sul piano frontale dell'arto inferiore lungo l'asse meccanico, in cui la linea articolare dovrebbe correre ad angolo retto rispetto a questo asse
 - Ricostruzione dei rapporti assiali fisiologici
 - Cinematica adatta alla protesi
 - linea articolare fisiologica
 - sufficiente stabilità mediale e laterale in estensione e in flessione
 - articolazione femoro-rotulea correttamente centrata e bilanciata
 - libera mobilità: dall'estensione massima fino alla massima possibile flessione
- La scelta dell'approccio chirurgico dipende dal disallineamento assiale (varo/valgo).

Preparazione del paziente

L'intervento va effettuato in anestesia generale o spinale, con un adeguato rilasciamento muscolare.

Il dolore postoperatorio può essere ridotto rinunciando all'uso di un laccio emostatico. Se è necessario applicare un laccio emostatico, posizionarlo sulla coscia prossimale e gonfiarlo con il ginocchio in iperflessione. In questo modo, la porzione maggiore del quadricipite rimane al di sotto del laccio emostatico.

Porre il paziente in posizione supina.

Flettere il ginocchio a 90°.

Usare un cilindro di supporto sul tavolo e un supporto laterale per facilitare l'estensione e la flessione della gamba.

Panoramica sulla tecnica chirurgica

1. Osteotomia femorale

				<p>Apertura del canale midollare e introduzione dell'asta intramidollare. Applicazione della guida di misura e rotazione femorale LIS. Determinazione dell'orientamento di rotazione e della misura del femore.</p> <p style="text-align: right;">> Pagina 10</p>
				<p>Preforatura dei due fori di alloggiamento per il blocco di taglio 4in1. Fissaggio del blocco di taglio distale per il femore.</p> <p>Osteotomia femorale distale.</p> <p style="text-align: right;">> Pagina 14</p>
				<p>Introduzione del blocco di taglio 4in1. Controllo della profondità di resezione prevista. Osteotomia femorale anteriore e posteriore con tagli obliqui.</p> <p style="text-align: right;">> Pagina 16</p>

2. Osteotomia tibiale

				<p>Applicazione e allineamento del sistema di riferimento tibiale parallelamente al margine anteriore della tibia. Impostazione dell'inclinazione dorsale. Determinazione del piano articolare originario e fissazione del sistema di riferimento tibiale.</p> <p style="text-align: right;">> Pagina 18</p>
				<p>Impostazione della profondità di resezione. Osteotomia tibiale. Determinazione della misura del piatto tibiale.</p> <p>Osservazione <i>Durante la resezione tibiale, posizionare i divaricatori a protezione dei legamenti.</i> > Pagina 19</p>


3.1 Preparazione e impianto: balanSys CR, UC e RP

				<p>Scanalatura della troclea. Introduzione del calibratore tibiale e dell'inserto di prova PE. Introduzione del femore di prova. Riduzione di prova del ginocchio.</p>
> Pagina 22				

			<p>I. Preparazione dei perni di fissaggio del femore II. Preparazione del canale midollare della tibia III. Preparazione dell'aletta</p>
> Pagina 24			

				<p>I. Introduzione del piatto tibiale balanSys II. Introduzione dell'inserto balanSys III. Inserimento del femore balanSys</p>
> Pagina 25				

3.2 Preparazione e impianto: balanSys PS

				<p>Preparazione del box femorale. Introduzione del femore di prova. Introduzione del calibratore tibiale e dell'inserto di prova PE. Riduzione di prova del ginocchio.</p>
> Pagina 28				

		<p>I. Preparazione del canale midollare della tibia II. Preparazione dell'aletta</p>
> Pagina 31		

				<p>I. Introduzione del piatto tibiale balanSys PS II. Introduzione del femore balanSys PS III. Introduzione dell'inserto balanSys PS</p>
> Pagina 32				

Osservazione

Le lame di sega da 1,27 mm sono compatibili con gli strumenti balanSys. Per quanto riguarda le lame di sega commercializzate da Mathys, vedere l'opuscolo 336.030.032 «Sterile Sawblades».

Tecnica chirurgica

1. Osteotomia femorale



Fig. 1 Apertura della cavità midollare

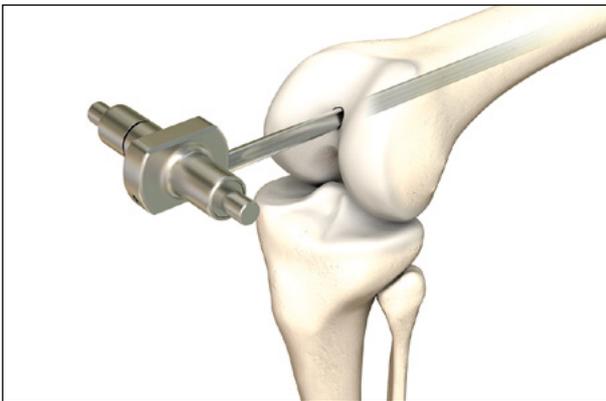


Fig. 2 Introduzione dell'asta intramidollare

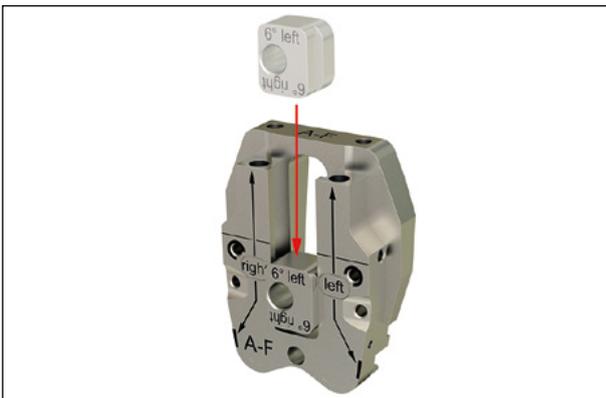


Fig. 3 Introduzione del blocco di allineamento dell'asse LIS

Allineamento intramidollare della resezione femorale

Aprire la cavità midollare con la punta da 8,5 mm (Fig. 1).

Osservazione

La cavità midollare femorale deve essere aperta nella sua corretta estensione assiale, per evitare un impianto non corretto in flessione ed estensione.

Introdurre l'asta intramidollare utilizzando l'impugnatura del sistema di riferimento tibiale. Prima di tutto, asportare gli osteofiti presenti (Fig. 2).

Posizionamento della guida di misura e rotazione femorale

Scegliere la misura della guida di misura e rotazione femorale (XS-D o A-F). Introdurre il blocco di allineamento dell'asse LIS (3°, 5°, 6°, 7° o 9°) nella guida di misura e rotazione femorale (Fig. 3). L'angolazione del blocco di allineamento dell'asse corrisponde all'angolo determinato in sede preoperatoria tra asse femorale meccanico e anatomico (angolo femorale in valgo).

Osservazione

Introdurre il blocco di allineamento dell'asse per la gamba destra o sinistra. «Sinistra» significa ginocchio sinistro; «destra» significa ginocchio destro. L'orientamento della scritta del blocco di allineamento dell'asse deve essere identico a quello della guida di misura e rotazione femorale.

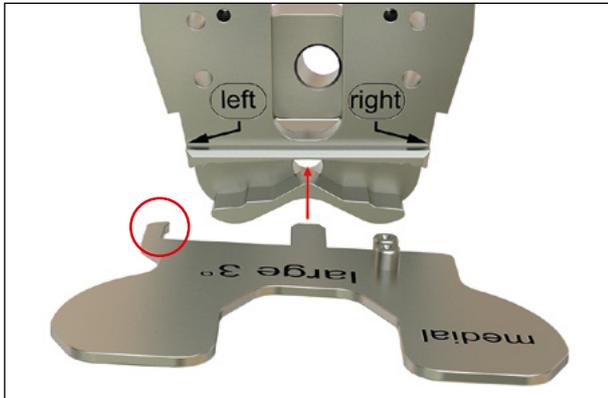


Fig. 4 Introduzione dell'appoggio di rotazione del femore

Per regolare la rotazione sono disponibili 3 angolazioni. In base all'angolazione, si può scegliere l'appoggio di rotazione del femore di 0°, 3° o 5°.

Introduzione dell'appoggio di rotazione del femore prescelto, piccolo o grande (Fig. 4).

Osservazione

L'indicatore dell'appoggio di rotazione del femore deve puntare verso il lato specificato (destra o sinistra) sulla guida di misura e rotazione femorale. Per il ginocchio sinistro, l'indicatore deve puntare verso «sinistra», per il ginocchio destro verso «destra» (Figg. 4 e 5).

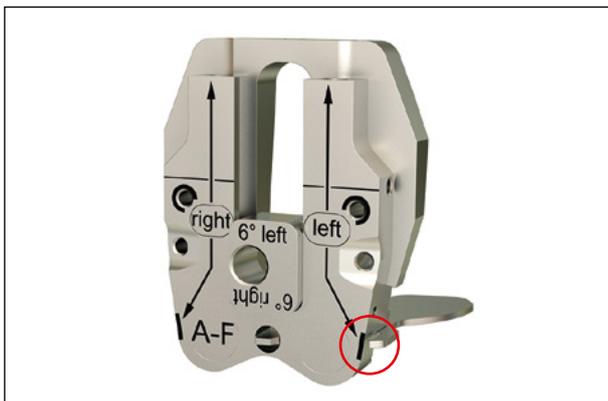


Fig. 5 Posizione dell'indicatore

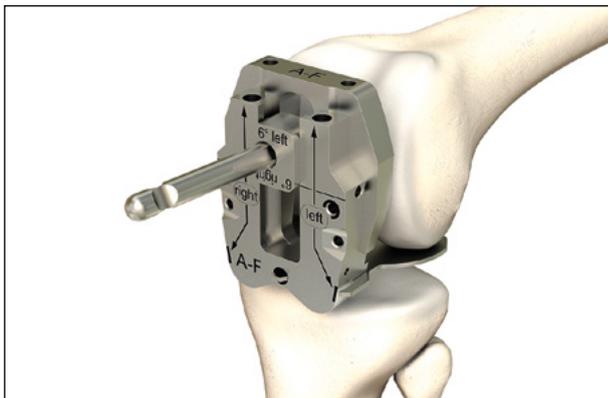


Fig. 6

Spingere la guida di misura e rotazione femorale sopra l'asta intramidollare attraverso il foro praticato nel blocco di allineamento dell'asse, fino all'arresto dello strumento in corrispondenza di un condilo distale (Fig. 6).


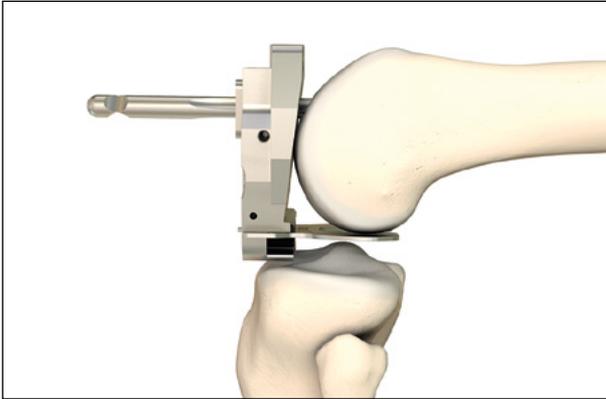


Fig. 7

Spingere lo strumento in direzione anteriore finché l'appoggio di rotazione del femore non tocca i condili posteriori su entrambi i lati (Fig. 7).

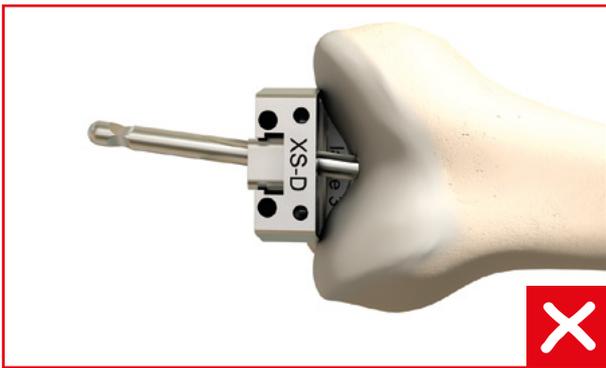

Se la guida di misura e rotazione femorale XS-D scivola tra i condili nello spazio intercondiloideo, occorre utilizzare la guida di misura e rotazione femorale A-F (Fig. 8).

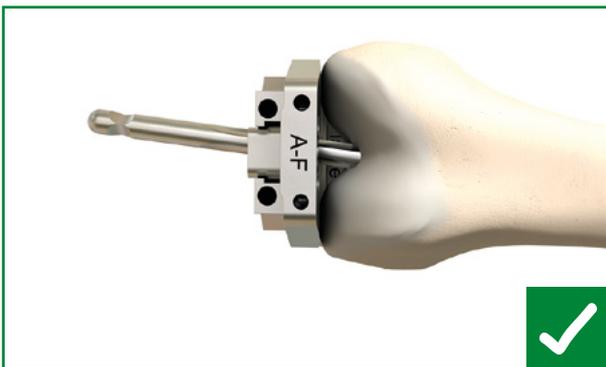


Fig. 8

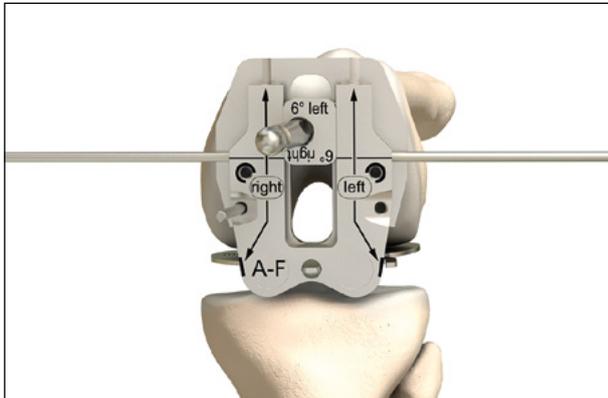


Fig. 9

La guida di misura e rotazione femorale può essere regolata di conseguenza, utilizzando la linea tracciata e i perni inseriti per l'estensione della linea sull'asse transepicondiloideo (Fig. 9).

Dopo la regolazione, fissare la guida di misura e rotazione femorale con un perno inserito nei fori obliqui nella parte bassa dello strumento. Preforare il foro con la punta da 3,2 mm.

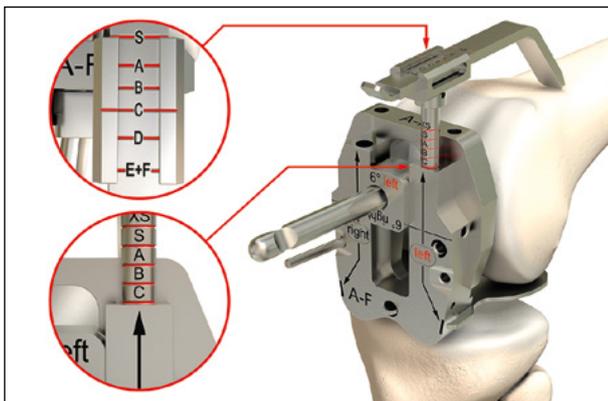


Fig. 10 Determinazione delle misure femorali

Determinare la misura femorale utilizzando l'apposito palpatore LIS, che viene posizionato sul punto più alto della metafisi femorale.

Introdurre il palpatore LIS sul relativo lato (destro/sinistro) della guida di misura e rotazione femorale (Fig. 10).

Leggere la misura del femore sulla scala anteriore e distale del palpatore LIS.

1. Leggere il segno sulla scala distale.
2. Trasferire il valore letto sulla scala anteriore.
3. I due valori devono corrispondere.

Osservazione

La misura del femore deve corrispondere alla misura della tibia (allegato 4).

Osservazione

In sede prossimale, il palpatore femorale LIS tocca la posizione in cui la punta della piastra femorale anteriore si arresta dopo l'impianto.

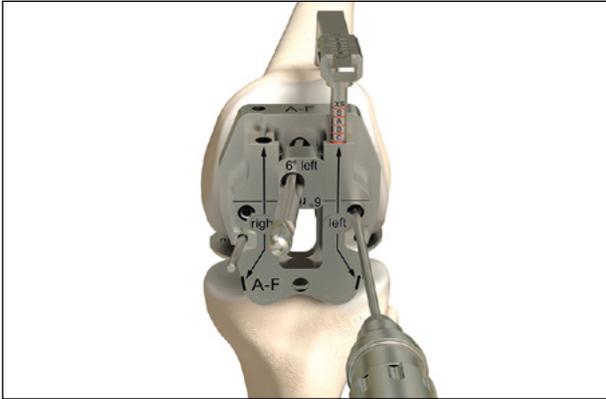


Fig. 11 Foratura dei due fori di alloggiamento con la punta da 3,2 mm

Dopo aver determinato la misura del femore, preparare i due fori per l'alloggiamento del blocco di taglio 4in1 (Fig. 11).

Osservazione

I due fori di alloggiamento devono essere abbastanza profondi da rimanere visibili anche dopo la resezione distale del femore.

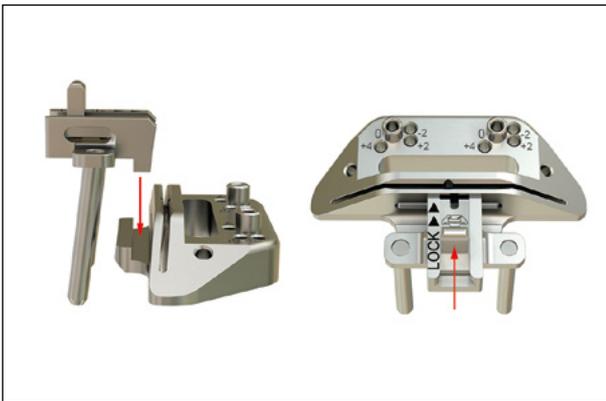


Fig. 12

Posizionare il blocco di taglio distale sul supporto LIS.

Spingere in avanti il cursore nel supporto LIS, fino ad agganciarlo in posizione (Fig. 12).



Fig. 13

Introdurre il supporto LIS con il blocco di taglio distale nel foro della guida di misura e rotazione femorale e spingerlo sul femore anteriore (Fig. 13).

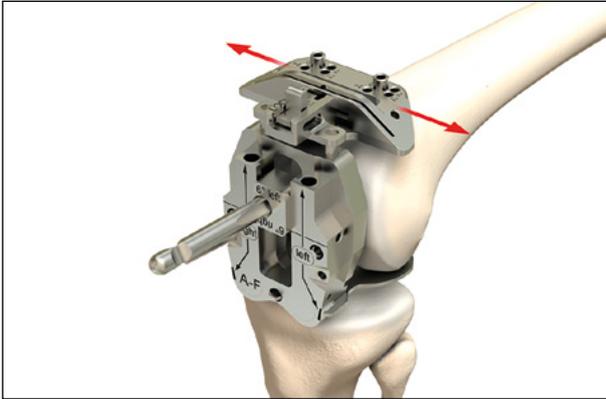


Fig. 14 Posizionamento del blocco di taglio distale

Il blocco di taglio distale può essere spostato in direzione medio-laterale in base alle condizioni anatomiche (Fig. 14).

Il blocco di taglio distale deve combaciare con il condilo anteriore.

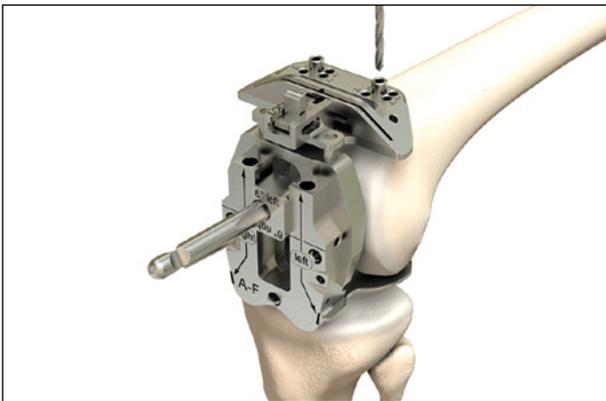


Fig. 15 Preforatura e inserimento di 2 perni

Preforatura dei due fori di riferimento per il blocco di taglio distale. Prestare attenzione al segno 0. Inserire due perni nei fori preforati anteriormente (Fig. 15).

Rimuovere gli strumenti nel seguente ordine:

1. Allentare il cursore sul supporto LIS, quindi estrarre il supporto dalla guida di misura e rotazione femorale LIS.
2. Estrarre la spina di fissaggio nella guida di misura e rotazione femorale.
3. Rimuovere la guida di misura e rotazione femorale con il blocco di allineamento dell'asse e l'appoggio di rotazione del femore.
4. Estrarre l'asta intramidollare.



Fig. 16 Controllo della superficie di resezione distale pianificata

Controllare il piano di resezione distale pianificato utilizzando l'apposito palpatore (Fig. 16).

Se necessario, spostare il blocco di taglio distale di +2/+4/-2 mm.

Osservazione

Il blocco di taglio distale può essere spostato per ottenere una tensione costante dei legamenti in flessione ed estensione.

Osservazione

Per una stabilità ottimale, fissare ulteriormente il blocco di taglio distale con un perno obliquo addizionale.

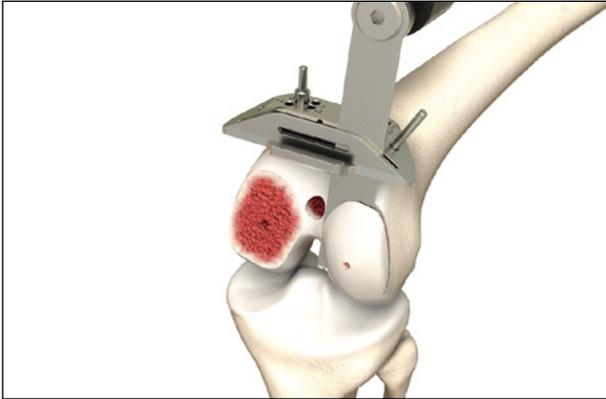


Fig. 17 Conduzione della resezione femorale distale

Conduzione della resezione femorale distale (Fig. 17).

Rimozione dei perni e del blocco di taglio distale.

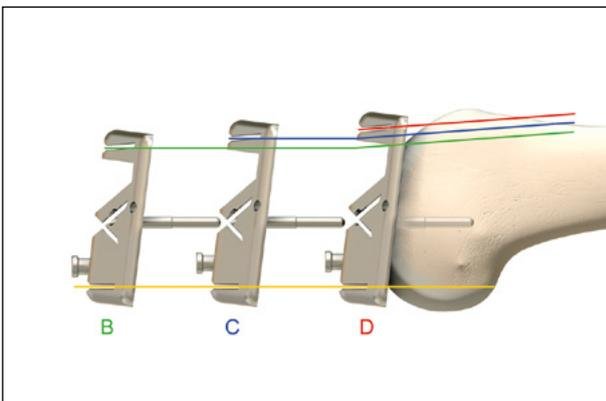


Fig. 18 Adattamento della misura del femore mediante modifica del blocco di taglio

Osservazione

*I livelli antero-posteriori dei componenti femorali balanSys **corrispondono a 3mm**. La distanza tra la sezione posteriore e il fissaggio con perni rimane per tutta la serie di blocchi di taglio esattamente la stessa, quindi tra le misure la fessura di flessione è costante (Fig. 18).*

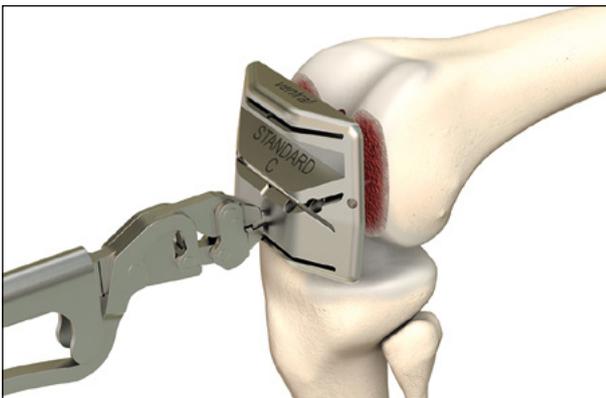


Fig. 19 Introduzione del blocco di taglio 4in1

Conduzione dell'osteotomia femorale anteriore e posteriore con tagli obliqui

Posizionare il blocco di taglio 4in1 prescelto con la pinza nei due fori già preparati, fino a farlo aderire a piatto sulla superficie di osteotomia distale (Fig. 19).



Fig. 20

Controllo della profondità di resezione prevista con il palpatore (Fig. 20). Fissaggio medio-laterale del blocco di taglio 4in1 con due perni.

Osservazione

Il blocco di taglio 4in1 può essere spostato anteriormente di 1,5 mm e posteriormente di 1,5 mm. Preforare i corrispondenti fori attraverso il blocco di taglio 4in1. Rimuovere il blocco di taglio 4in1 con l'ausilio della pinza e introdurlo nei nuovi fori appena preparati, fino a farlo aderire a piatto sulla superficie di osteotomia distale.

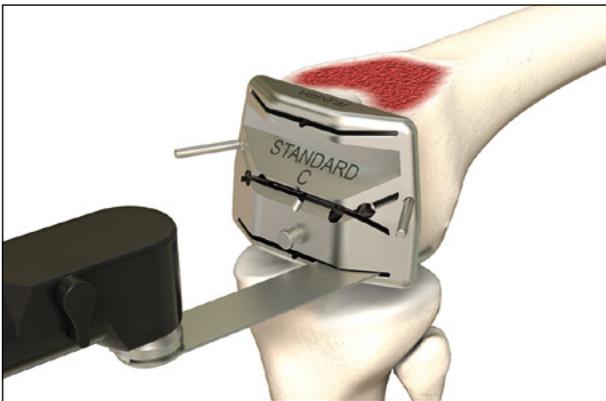


Fig. 21 Conduzione delle osteotomie

Conduzione delle osteotomie (Fig. 21) nel seguente ordine:

1. Osteotomia anteriore
2. Osteotomia posteriore
3. Tagli obliqui

Osservazione

Le osteotomie posteriori vanno condotte con una flessione del ginocchio di 90°. Questo da un lato previene il contatto della superficie tibiale con la lama, dall'altro i tessuti molli posteriori vengono tenuti lontani dai condili.

Rimozione del blocco di taglio 4in1 con la pinza.

Rimuovere tutti i frammenti ossei marginali e gli osteofiti, soprattutto nel distretto dei condili posteriori.

Tecnica chirurgica

2. Osteotomia tibiale

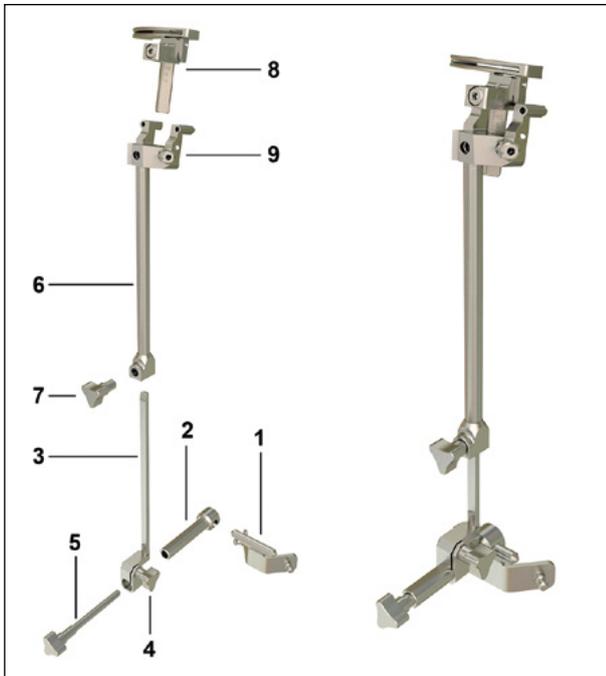


Fig. 22

Montaggio del sistema di riferimento tibiale con allineamento extramidollare (Fig. 22)

Spingere la forcella (1) sul porta-forcella (2). Spingere il mirino distale (3) sul porta-forcella (2) e fissare la forcella con la vite della forcella (5). Non serrare completamente la vite di connessione (4). Congiungere il mirino distale (3) con il mirino prossimale (6) e fissare con la vite di connessione (7). Spingere la guida di taglio tibiale (8) sul mirino prossimale (6). Impostare la guida di taglio sullo 0 e serrare la vite (9) con il cacciavite esagonale.

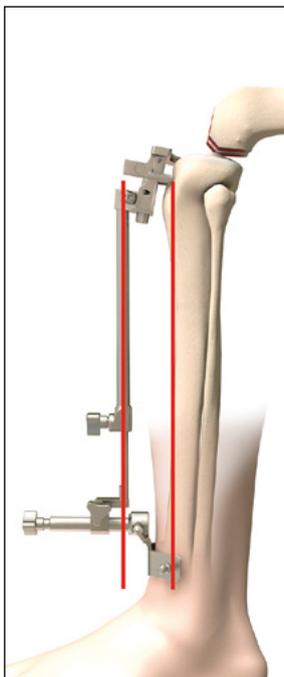


Fig. 23 Applicazione del sistema di riferimento tibiale



Fig. 24 Allineamento del sistema di riferimento tibiale

Posizionamento del sistema di riferimento tibiale con allineamento extramidollare

Il sistema di riferimento viene posizionato parallelamente al margine tibiale anteriore (Fig. 23). Allineare il sistema di riferimento tibiale distalmente sul secondo raggio del piede e fissare con il nastro di gomma (Fig. 24). Per un corretto allineamento di rotazione, il centro della guida di taglio tibiale va allineato sul passaggio dal terzo mediale al terzo medio della tuberosità della tibia. In alternativa, la guida di taglio può essere anche posizionata parallelamente alla linea tra i margini posteriori del piatto tibiale mediale e laterale.

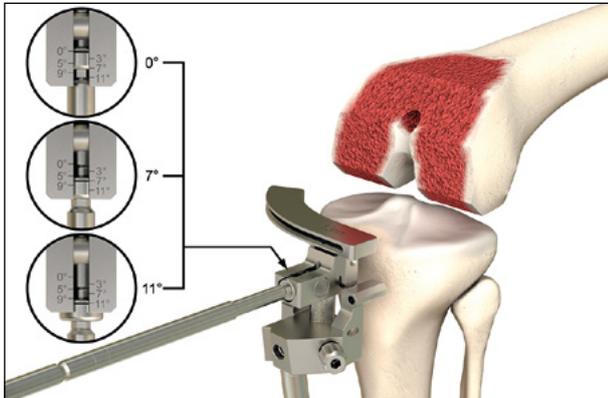


Fig. 25 Impostazione dell'inclinazione dorsale

Impostazione dell'inclinazione dorsale

Mediante il cacciavite esagonale, impostare l'inclinazione dorsale secondo l'anatomia (palpatore parallelo alla superficie articolare meglio conservata della tibia) (Fig. 25).

Osservazione

Gli autori consigliano un'inclinazione posteriore fino a 7° per gli impianti con conservazione del LCP e fino a 5° per gli impianti con sostituzione del LCP.

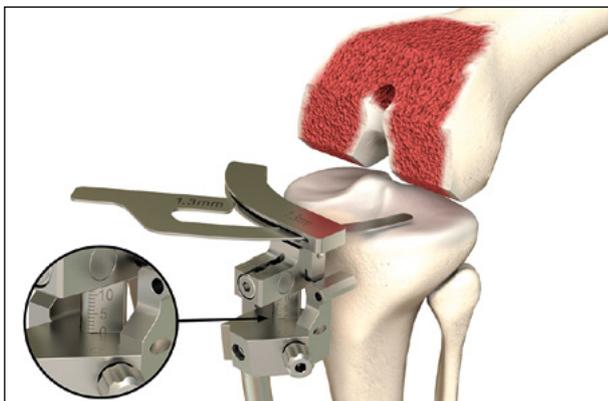


Fig. 26 Determinazione del piano articolare originario

Con il palpatore o con il palpatore di altezza tibiale opzionale, determinare il piano articolare originario all'altezza della superficie articolare meglio conservata della tibia (Fig. 26).



Fig. 27 Fissaggio del sistema di riferimento tibiale

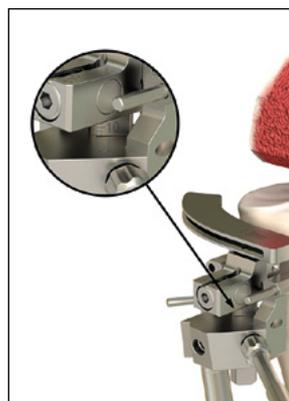


Fig. 28 Impostazione della profondità di resezione tibiale

Fissaggio del sistema di riferimento tibiale

Fissare il sistema di riferimento prossimalmente con almeno due perni nei fori predisposti (obliquo e diretto) (Fig. 27). I fori vengono preforati con la punta da 3,2 mm.

Osteotomia tibiale

Con il cacciavite esagonale, spostare la guida di taglio tibiale di 6–8 mm in direzione distale (Fig. 28).

Controllare con il palpatore il piano di osteotomia impostato.



Fig. 29 Conduzione dell'osteotomia tibiale

Conduzione dell'osteotomia tibiale (Fig. 29) e asportazione dei residui del menisco posteriore.

Osservazione

Durante la resezione tibiale, posizionare i divaricatori a protezione dei legamenti.

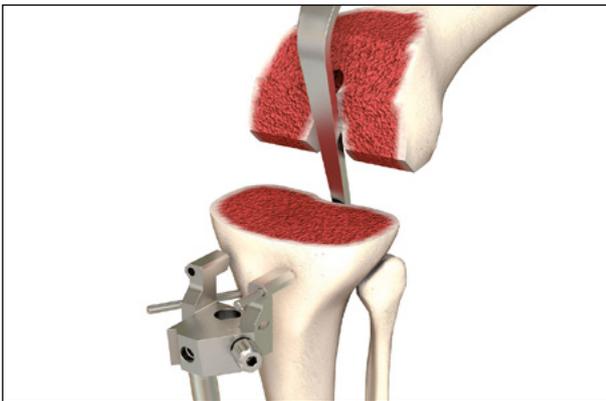


Fig. 30

Rimuovere la guida di taglio tibiale (Fig. 30).

Osservazione

Nel rimuovere il sistema di riferimento tibiale, lasciare in situ un perno come riferimento per un'eventuale successiva resezione.

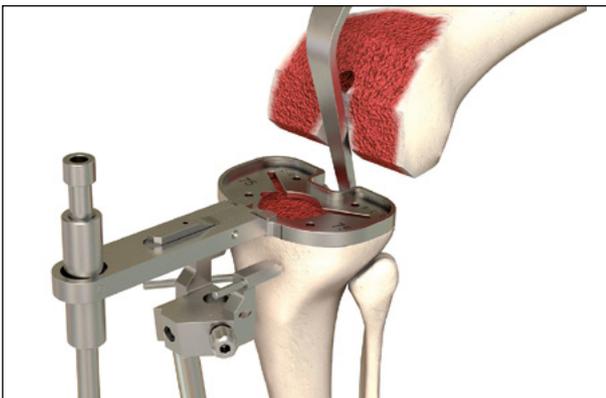


Fig. 31 Determinazione della misura della protesi tibiale

Determinazione della misura della protesi tibiale

Con il calibratore tibiale, determinare la misura della protesi tibiale, tenendo conto dell'allineamento di rotazione (Fig. 31). Lo scopo è quello di ottenere la massima copertura della superficie di osteotomia. Con il regolo, controllare l'asse e l'inclinazione del piano di taglio.

Oltre all'osteotomia tibiale con allineamento extramidollare, è possibile anche un allineamento intramidollare (vedere allegato 1).

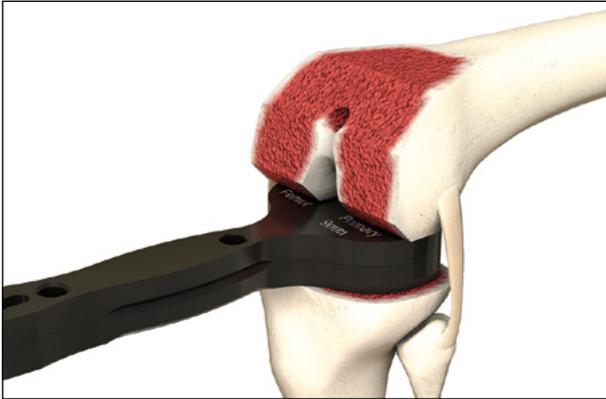


Fig. 32 Controllo della fessura di flessione

Controllo della fessura di flessione

- Introduzione del piatto di base del blocco spaziatore nella fessura di flessione con l'inserto del blocco spaziatore precedentemente definito in estensione (Fig. 32)
- Valutazione della stabilità dei legamenti mediali e laterali

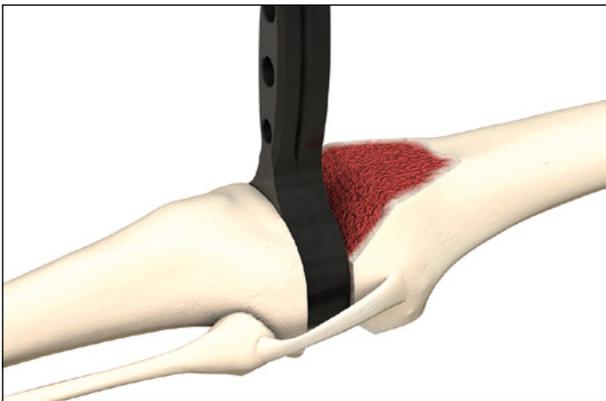


Fig. 33 Controllo della fessura di estensione

Controllo della fessura di estensione

Controllo della fessura di estensione con l'introduzione del piatto di base del blocco spaziatore con rispettivo inserto del blocco spaziatore (Fig. 33).

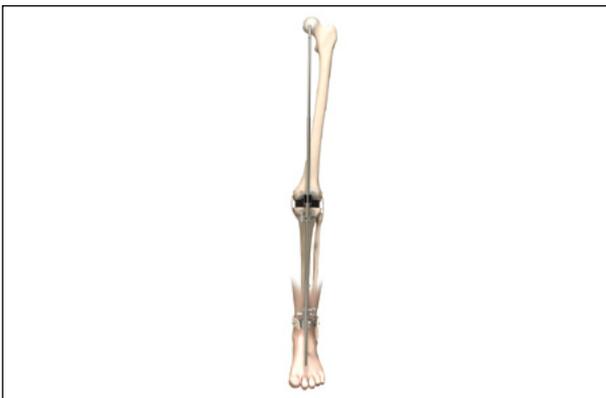


Fig. 34

Controllo dell'asse meccanico (Fig. 34), della stabilità mediale e laterale e della capacità di estensione. In caso di tensione troppo elevata, si può praticare un'altra resezione sul femore distale o sulla tibia.

Rimozione del blocco spaziatore.

Tecnica chirurgica

3. Preparazione e impianto

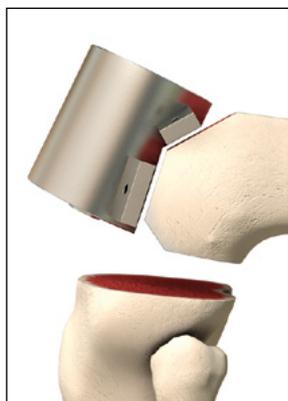


Fig. 35 Posizionamento della guida per fresa trocleare

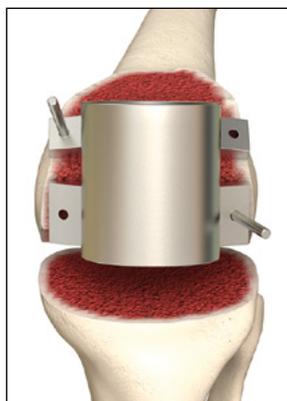


Fig. 36 Fissaggio della guida per fresa trocleare



Fig. 37

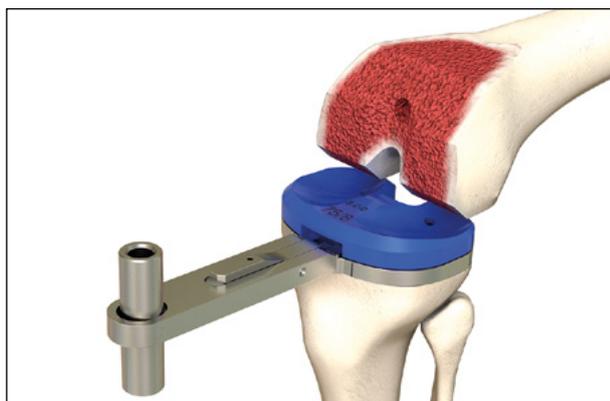


Fig. 38 Introduzione della protesi tibiale di prova

3.1 balanSys CR, UC e RP

Preparazione del femore

Posizionare la guida per fresa trocleare per la preparazione della troclea sul femore (Fig. 35) e fissarla diagonalmente con almeno due perni (Fig. 36).

Osservazione

Per uno scorrimento ottimale della rotula, gli autori raccomandano di posizionare la guida per fresa trocleare in sede lievemente laterale.

Scanalatura della troclea con la fresa trocleare fino all'arresto (Fig. 37).

Rimozione di tutti gli strumenti.

Introduzione del corrispondente inserto di prova PE della misura precedentemente determinata con il calibratore tibiale (Fig. 38).

Osservazione

Accertarsi che il componente di prova prescelto ricopra la tibia come desiderato e che venga osservata la misura del femore prescelta.

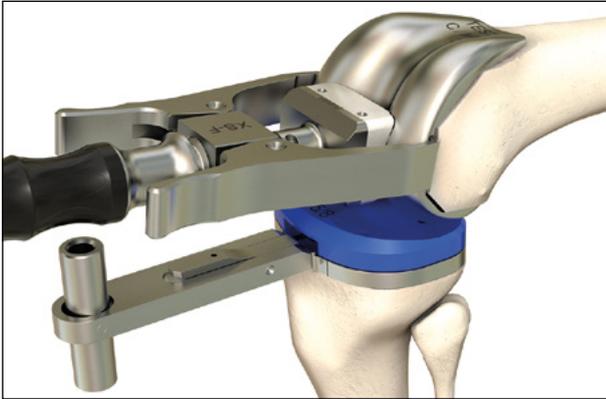


Fig. 39 Introduzione del femore di prova

Introduzione del femore di prova (Fig. 39) con l'ausilio dell'ansa femore e fissaggio con l'impattatore femorale (Fig. 40).

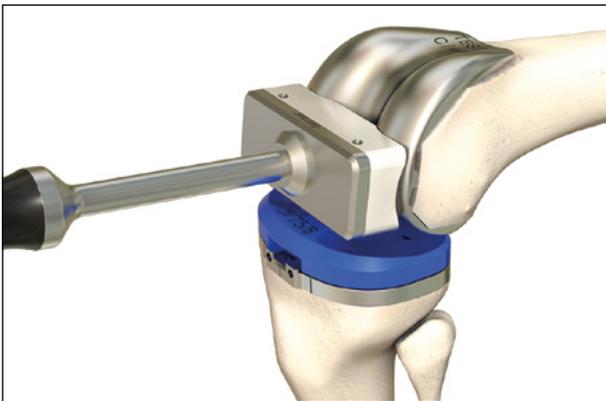


Fig. 40 Fissaggio con l'impattatore femorale

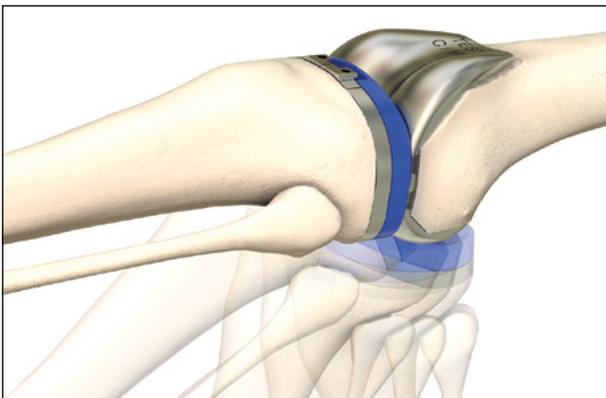


Fig. 41 Escursione articolare completa del ginocchio

Riduzione dell'apparato estensore.

Osservazione

Nella sostituzione della rotula, gli autori raccomandano di condurre l'osteotomia patellare e l'applicazione dei componenti patellari di prova prima che il ginocchio venga mobilizzato.

Dopo l'introduzione di tutti i componenti provvisori, mobilizzazione articolare completa del ginocchio, controllo di stabilità, cinematica e mobilità (Fig. 41).

Marcatura anteriore del calibratore tibiale con il dispositivo elettrochirurgico sulla testa della tibia.

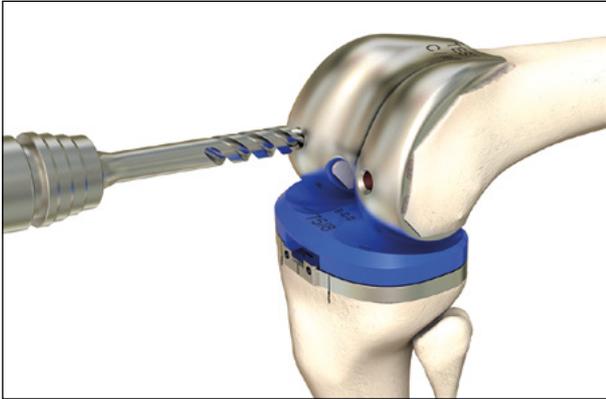


Fig. 42 Foratura per i perni di fissaggio del femore

Realizzazione dei due fori per i perni di fissaggio del femore (Fig. 42).

Rimozione del femore di prova e dell'inserto di prova PE.



Fig. 43 Fissaggio del calibratore tibiale

Preparazione della tibia

Fissaggio del calibratore tibiale con due perni (Fig. 43) tenendo conto della marcatura sulla testa della tibia.



Fig. 44a



Fig. 44b

L'alesatore tibiale deve essere collegato a un trapano. Posizionare la guida per alesatore sul calibratore tibiale. Introdurre i tre perni nelle aperture del calibratore tibiale. Osservare la marcatura «**ventral**». Ruotando delicatamente in senso orario l'alesatore fino all'arresto, collegare la guida per alesatore al calibratore tibiale. In questa posizione, l'unità composta da guida per alesatore e calibratore tibiale è bloccata (Fig. 44a). Trapanare il canale midollare tibiale (Fig. 44b).

La profondità deve corrispondere alla lunghezza appropriata del fissaggio dello stelo del piatto tibiale balanSys PS precedentemente determinata. Sull'alesatore sono impresse delle marcature di misura.

Rimozione della guida per alesatore.

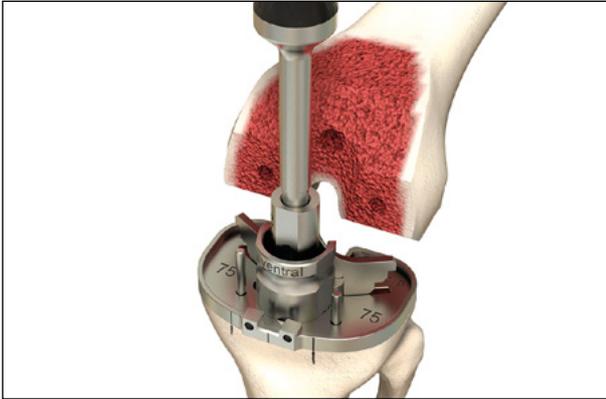


Fig. 45 Battitura del bullone di fissaggio

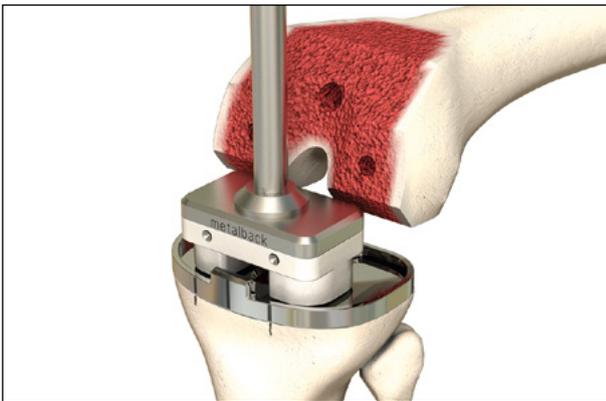


Fig. 46



Fig. 47

Collegare lo scalpello per alette all'impugnatura.

Posizionare la guida di centratura per scalpello sul calibratore tibiale. Introdurre i tre perni nelle aperture del calibratore tibiale. Osservare la marcatura «**ventral**». Ruotando delicatamente in senso orario la guida di centratura per scalpello fino all'arresto, bloccare la guida per alesatore nel calibratore tibiale. In questa posizione, l'unità composta da guida di centratura per scalpello e calibratore tibiale è bloccata. Battere con prudenza sul complesso comprendente lo scalpello per alette, per evitare una frattura della tibia (Fig. 45).

Procedere con prudenza nell'introduzione dello scalpello per alette in caso di accesso mediale, per evitare lesioni del legamento collaterale laterale e del tendine popliteo.

Battere fino al contatto dello strumento con il calibratore tibiale. La profondità delle alette viene determinata dalla misura del calibratore tibiale.

Rimozione di tutti gli altri strumenti.

Pulizia accurata delle superfici di osteotomia (es. con lavaggio a pressione pulsata).

Impianto definitivo

Quando viene applicato, il cemento deve trovarsi nella fase iniziale di consistenza pastosa. Seguire le istruzioni specifiche per il cemento osseo prescelto.

Per un fissaggio sicuro del piatto tibiale sull'osso è necessario che la parte posteriore della tibia venga cementata completamente durante la fase di consistenza pastosa del cemento. Lo stelo e le alette possono, ma non devono necessariamente essere cementate.

Se il piatto tibiale non viene cementato e impattato completamente, esiste il rischio di allentamento precoce della protesi. Inoltre, anche la cementazione in fase avanzata di polimerizzazione può portare all'allentamento precoce della protesi.

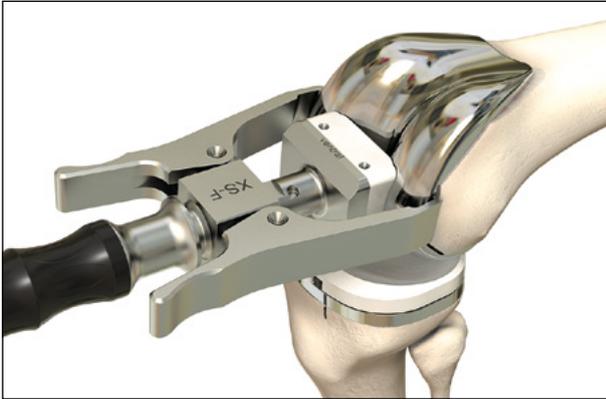


Fig. 48

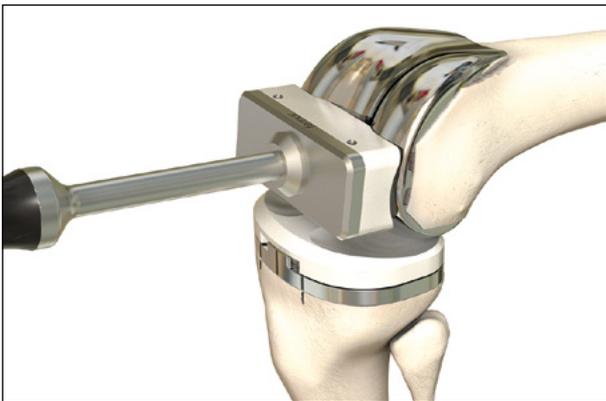


Fig. 49



Fig. 50

Osservazione

Accertarsi di distribuire il cemento accuratamente, per evitare un eccesso nel distretto dorsale del femore e del componente femorale, perché successivamente è difficile asportare il cemento.

Introduzione del piatto tibiale balanSys con l'ausilio dell'impattatore tibiale (Fig. 46).

Introduzione dell'inserto balanSys (Fig. 47).

Impianto del femore balanSys (cementato o non cementato) mediante l'ansa femore (Fig. 48) e battitura definitiva con l'impattatore femorale (Fig. 49).

Durante l'indurimento del cemento osseo, posizionare l'arto in estensione (Fig. 50).

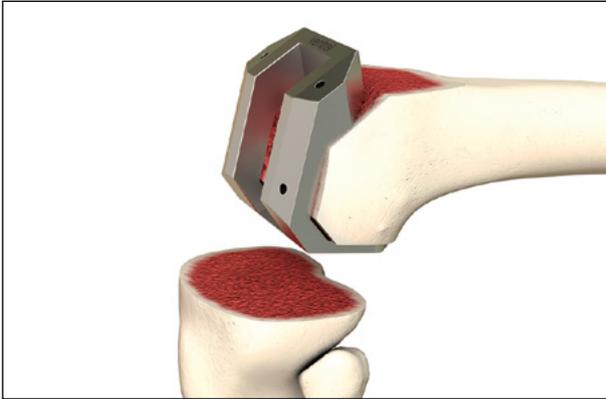


Fig. 51 Posizionamento della guida di resezione del box femorale

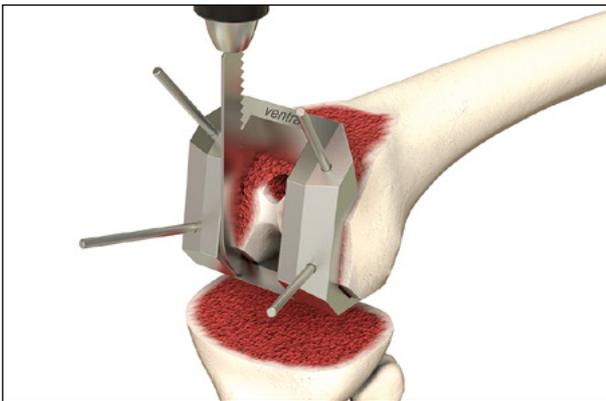


Fig. 52

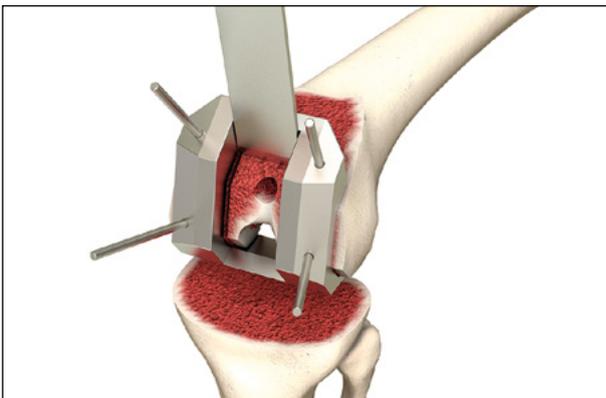


Fig. 53

3.2 balanSys PS

Preparazione del femore

Posizionare sul femore una guida di resezione del box femorale di misura adeguata. Essa deve aderire con precisione alle superfici di resezione posteriore e distale del femore (Fig. 51).

Osservazione

Per uno scorrimento ottimale della rotula, gli autori raccomandano di posizionare la guida di resezione del box femorale in sede lievemente laterale.

La guida aderente alle superfici di resezione deve essere assicurata diagonalmente al femore con quattro perni. I perni posteriori vanno inseriti per primi.

Condurre una sega oscillante lungo le pareti della guida di resezione del box, per condurre i tagli sulle facce mediale e laterale e alla base dello spazio intercondiloideo (Fig. 52).

La base dello spazio intercondiloideo può essere opzionalmente escissa con uno scalpello balanSys (Fig. 53).

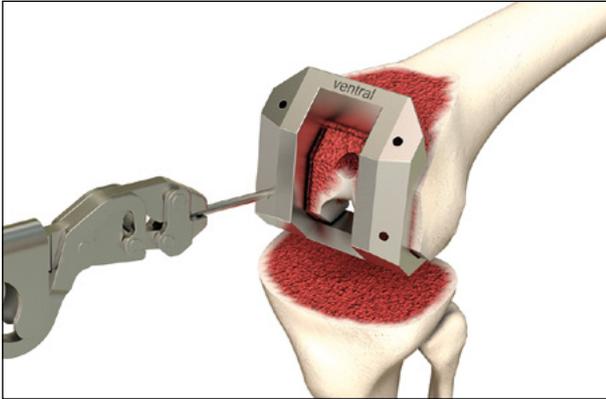


Fig. 54 Rimozione dei perni con la pinza

Dopo la conduzione della resezione, rimuovere la guida di resezione del box femorale e i perni (Fig. 54) nel seguente ordine:

1. Perna
2. Guida di resezione
3. Blocchetto di osso resecato

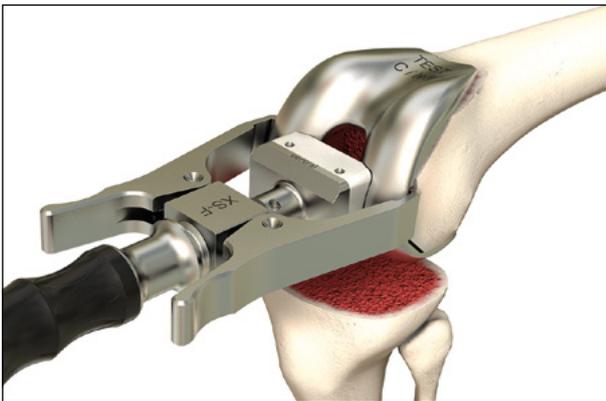


Fig. 55 Introduzione del femore di prova

Determinazione della posizione definitiva dell'impianto

Introduzione del femore di prova con l'ansa femore (Fig. 55).



Fig. 56 Fissaggio con l'impattore femorale

Il fissaggio definitivo avviene con l'impattore femorale (Fig. 56).



Fig. 57 Introduzione del calibratore tibiale e dell'inserto di prova PE

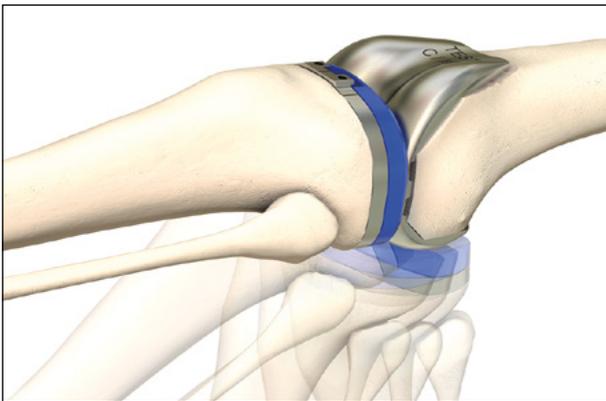


Fig. 58 Escursione articolare completa del ginocchio

Quando il componente femorale è stato introdotto, la tibia va sublussata in direzione anteriore con un divaricatore di Hohmann, per posizionare il calibratore tibiale e l'inserto di prova PE (Fig. 57).

Introduzione del calibratore tibiale e dell'inserto di prova PE della misura predefinita e posizionamento sulla tibia resecata.

Osservazione

Accertarsi che il componente di prova prescelto ricopra la tibia come desiderato e che venga osservata la misura del femore prescelta.

Riduzione dell'apparato estensore.

Osservazione

Nella sostituzione della rotula, gli autori raccomandano di condurre l'osteotomia patellare e l'applicazione dei componenti patellari di prova prima che il ginocchio venga mobilizzato.

Dopo l'introduzione di tutti i componenti di prova PS, controllare la massima escursione di movimento, la stabilità, la cinematica e la mobilità del ginocchio (Fig. 58).

Il componente tibiale si allinea di regola spontaneamente secondo il componente femorale. Gli aggiustamenti necessari vanno effettuati prima della marcatura della posizione definitiva.

Dopo il posizionamento definitivo, la posizione delle linee laser sul calibratore tibiale anteriore viene riportata sulla tibia con un cauterizzatore.

Rimozione dell'inserto di prova PE e del femore di prova.



Fig. 59 Fissaggio con perni



Fig. 60 Posizionamento della guida per alesatore

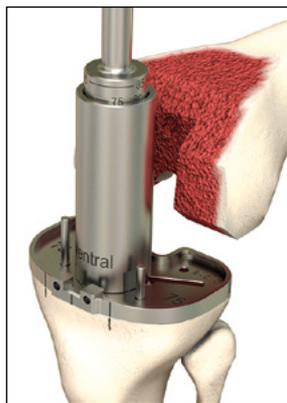


Fig. 61 Trapanare il canale midollare tibiale

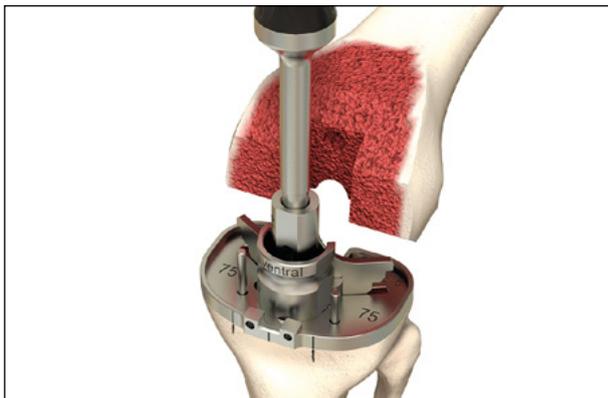


Fig. 62 Preparazione dell'aletta

Preparazione della tibia

Riduzione del calibratore tibiale secondo la marcatura con cauterizzatore e fissaggio con due perni anteriori (Fig. 59).

L'alesatore tibiale deve essere collegato a un trapano.

Posizionare la guida per alesatore sul calibratore tibiale. Introdurre i tre perni nelle aperture del calibratore tibiale. Osservare la marcatura **«ventral»**. Ruotando delicatamente in senso orario l'alesatore fino all'arresto, collegare la guida per alesatore al calibratore tibiale. In questa posizione, l'unità composta da guida per alesatore e calibratore tibiale è bloccata (Fig. 60). Trapanare il canale midollare tibiale (Fig. 61).

La profondità deve corrispondere alla lunghezza appropriata del fissaggio dello stelo del piatto tibiale balanSys PS precedentemente determinata. Sull'alesatore sono impresse delle marcature di misura.

Rimozione della guida per alesatore.

Collegare lo scalpello per alette all'impugnatura.

Posizionare la guida di centratura per scalpello sul calibratore tibiale. Introdurre i tre perni nelle aperture del calibratore tibiale. Osservare la marcatura **«ventral»**. Ruotando delicatamente in senso orario la guida di centratura per scalpello fino all'arresto, bloccare la guida per alesatore nel calibratore tibiale. In questa posizione, l'unità composta da guida di centratura per scalpello e calibratore tibiale è bloccata. Battere con prudenza sul complesso comprendente lo scalpello per alette, per evitare una frattura della tibia (Fig. 62).

Procedere con prudenza nell'introduzione dello scalpello per alette in caso di accesso mediale, per evitare lesioni del legamento collaterale laterale e del tendine popliteo.

Battere fino al contatto in basso dello strumento con il calibratore tibiale. La profondità delle alette viene determinata dalla misura del calibratore tibiale.

Rimozione di tutti gli altri strumenti.

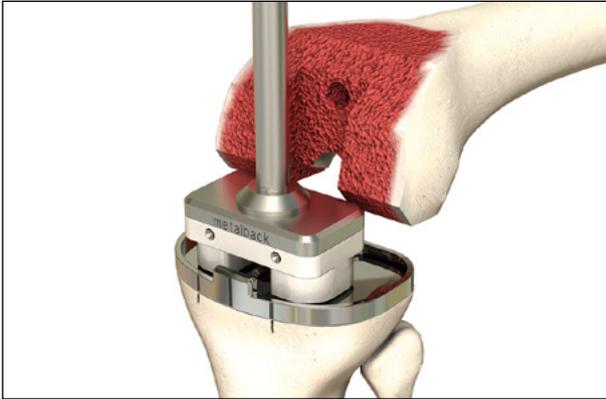


Fig. 63 Introduzione e battitura del componente tibiale



Fig. 64 Introduzione del femore



Fig. 65 Battitura definitiva con impattatore femorale

Impianto definitivo balanSys PS

Dopo la scelta degli impianti, si raccomanda un controllo finale per accertarsi che femore, tibia e inserto siano compatibili fra di loro.

Quando viene applicato, il cemento deve trovarsi nella fase iniziale di consistenza pastosa. Seguire le istruzioni specifiche per il cemento osseo prescelto.

Per un fissaggio sicuro del piatto tibiale sull'osso è necessario che la parte posteriore della tibia venga cementata completamente durante la fase di consistenza pastosa del cemento. Lo stelo e le alette possono, ma non devono necessariamente essere cementate.

Se il piatto tibiale non viene cementato e impattato completamente, esiste il rischio di allentamento precoce della protesi. Inoltre, anche la cementazione in fase avanzata di polimerizzazione può portare all'allentamento precoce della protesi.

Osservazione

Accertarsi di distribuire il cemento accuratamente, per evitare un eccesso nel distretto dorsale del femore e del componente femorale, perché successivamente è difficile asportare il cemento.

Nell'impianto definitivo, il ginocchio deve essere in flessione.

Introduzione del piatto tibiale balanSys e battitura con l'impattatore tibiale (Fig. 63).

Introduzione del componente femorale balanSys PS con l'ansa femore (Fig. 64). Proteggere i condili femorali del femore balanSys PS da eventuali lesioni da graffiatura.

Battitura definitiva con l'impattatore femorale (Fig. 65).

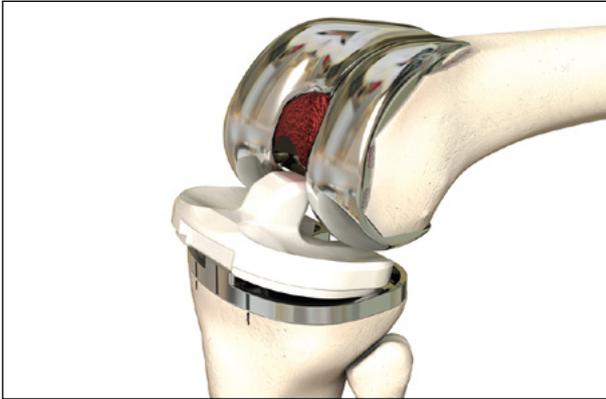


Fig. 66

Osservazione

Asportare il cemento in eccesso. Si raccomanda espressamente di asportare il cemento in eccesso con la massima cura lungo il distretto prossimale del componente femorale e del box femorale. La superficie del piatto tibiale va ripulita.

Introduzione dell'inserto balanSys PS (Fig. 66).



Fig. 67

Durante l'indurimento del cemento osseo, posizionare l'arto in estensione (Fig. 67).

Osservazione

Dopo l'introduzione dell'inserto e l'indurimento del cemento osseo, i residui di cemento all'interno del box femorale vanno asportati con la massima cura.

Allegato

1 – Osteotomia tibiale con allineamento intramidollare

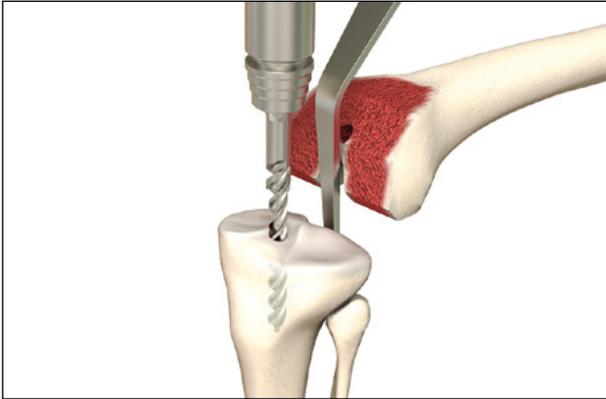


Fig. 68 Apertura del canale midollare

L'osteotomia tibiale può essere anche effettuata con allineamento intramidollare.

Il canale midollare viene aperto lungo l'asse longitudinale in corrispondenza dell'eminanza con una punta da 8,5mm (Fig. 68).

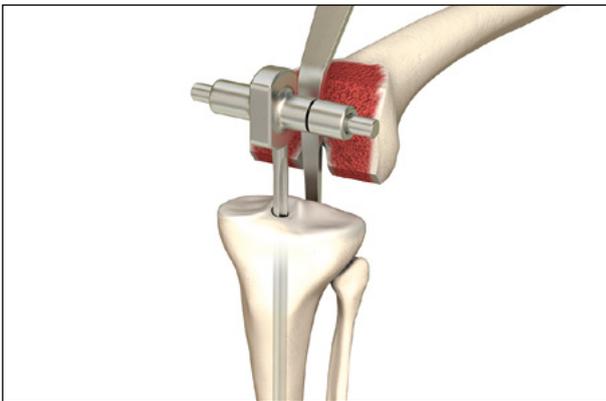


Fig. 69

Lenta introduzione dell'asta intramidollare srt (Fig. 69).

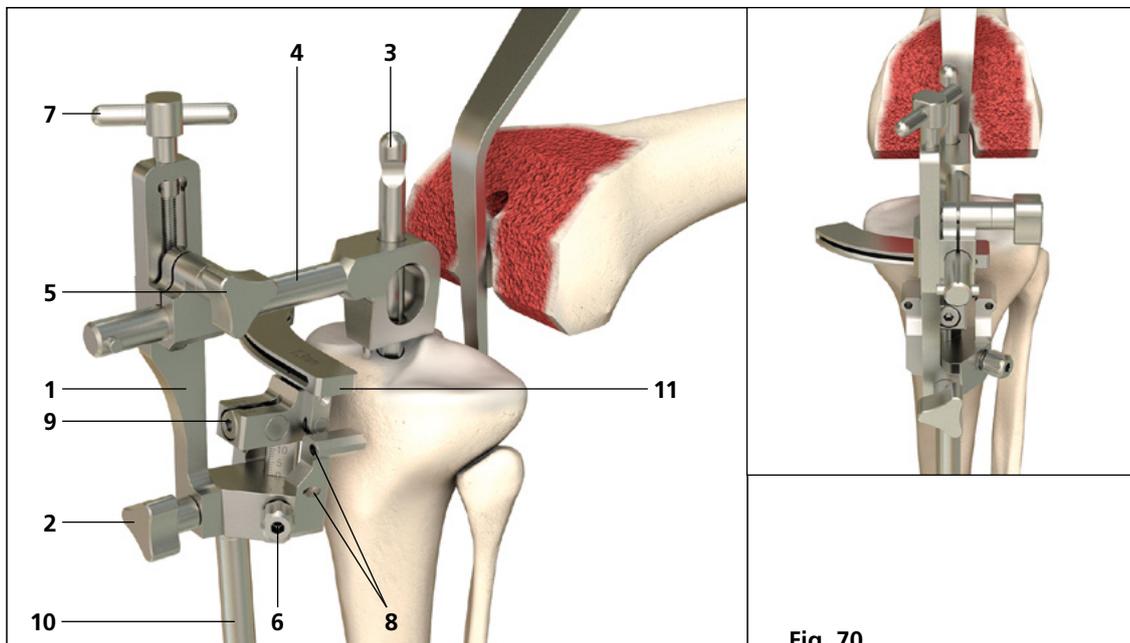


Fig. 70

Posizionamento del sistema di riferimento tibiale con allineamento intramidollare (Fig. 70)

- Accoppiamento del sistema di riferimento tibiale intramidollare (1) con il mirino srt prossimale (10)
- Fissaggio con la vite (2)
- Applicazione dello strumentario premontato sull'asta intramidollare srt (3)
- Allineamento distale del sistema di riferimento tibiale sul secondo raggio del piede e prossimale sul passaggio dal terzo mediale al terzo medio della tuberosità tibiale
- Battitura del manico (4)
- Impostazione dell'angolo varo-valgo con vite di regolazione (5)
- Impostare inizialmente la guida di taglio tibiale (11) sullo 0 e fissarla con la vite (6). Determinare l'inclinazione. Con un cacciavite esagonale, impostare l'inclinazione posteriore secondo le caratteristiche anatomiche a scelta da 0° a 11° (9)
- Determinazione del piano articolare originario mediante palpatore o palpatore di altezza tibiale all'altezza della superficie articolare meglio conservata della tibia
- Impostazione della linea articolare con l'ausilio della vite a T (vite longitudinale) (7)
- Fissaggio del sistema di riferimento prossimale con almeno due perni nei fori predisposti (obliquo e diretto) (8)
- I fori vengono preforati con la punta da 3,2 mm
- Con il cacciavite esagonale, spostamento della guida di taglio tibiale di 6–8 mm in direzione distale (6)
- Controllo del piano di osteotomia impostato con il palpatore
- Rimozione della vite per il fissaggio del manico intramidollare (2), dell'asta intramidollare tibiale e dello strumento di resezione tibiale con allineamento intramidollare (1, 3, 4)

Osservazione

Gli autori consigliano un'inclinazione posteriore fino a 7° per gli impianti con conservazione del LCP e fino a 5° per gli impianti con sostituzione del LCP.

Per la continuazione, vedere la sezione «Osteotomia tibiale» (Fig. 29).

Allegato

2 – Rotula balanSys 3 perni



Fig. 71

Asportazione di tutti gli osteofiti marginali.

Determinazione della misura della rotula sulla base delle caratteristiche anatomiche.

Dia	PIANA 3 perni	3 perni
26	8 mm	–
28	8 mm	10,2 mm
31	8 mm	11,4 mm
34	9 mm	12,3 mm
37	9 mm	13,0 mm



Fig. 72

Rovesciare la rotula verso l'esterno e afferrarla centralmente con la pinza per rotula.

Allineare l'altezza di resezione con l'appoggio tensivo all'impostazione di misura scelta per la rotula.

Osservazione

Accertarsi di usare la pinza per resezione rotula piana per la rotula 3 perni PIANA (misure **26**–37) e la pinza per resezione rotula standard per la rotula 3 perni (misure **28**–37), rispettivamente.

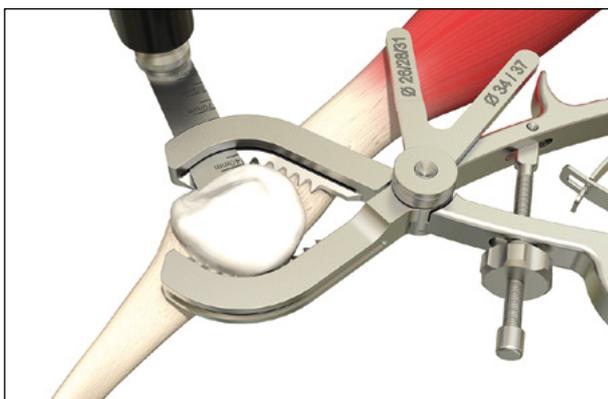


Fig. 73

Conduzione dell'osteotomia patellare mediante la guida della sega sulla parte laterale della pinza per rotula.

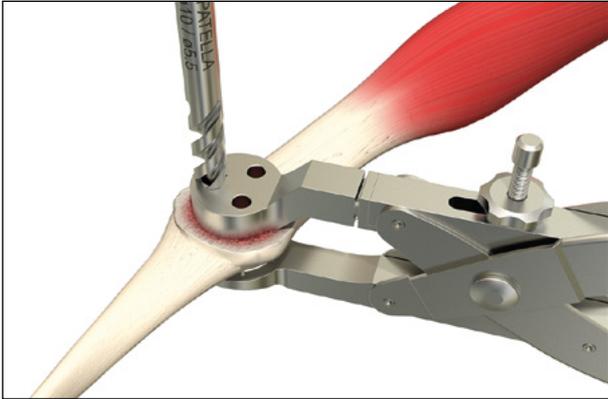


Fig. 74

Posizionamento della guida di foratura per la determinazione della posizione definitiva dell'impianto patellare rispetto alla via di scorrimento predeterminata dello scudo femorale.

Preforatura delle aperture per i tre perni rotulei con la punta da 5,5 mm.

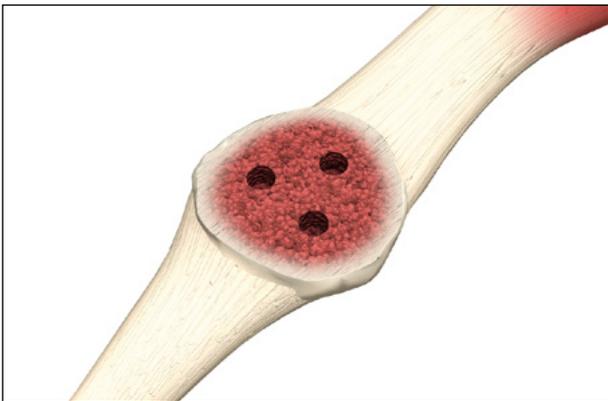


Fig. 75

Superficie retropatellare preparata per l'impianto.



Fig. 76

Introduzione della rotula di prova della misura predeterminata (PIANA o standard).

Tagliare obliquamente i margini mediale e laterale della superficie patellare posteriore.

Controllo del movimento di scivolamento nell'articolazione femoro-patellare per verificare il centramento.

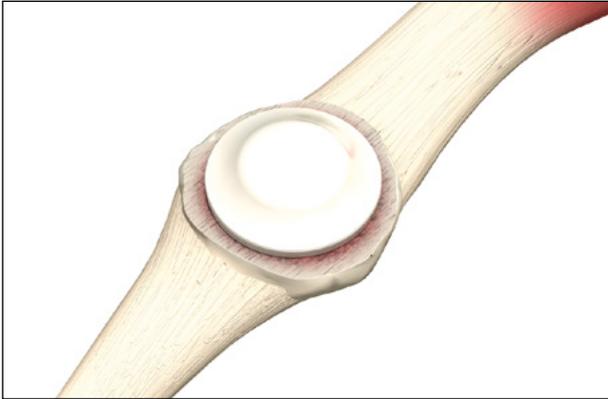


Fig. 77

Accurata pulizia della superficie dell'osteotomia.

Introduzione della rotula cementata balanSys 3 perni con l'ausilio del morsetto di cementazione.

Asportazione dei residui di cemento marginali.

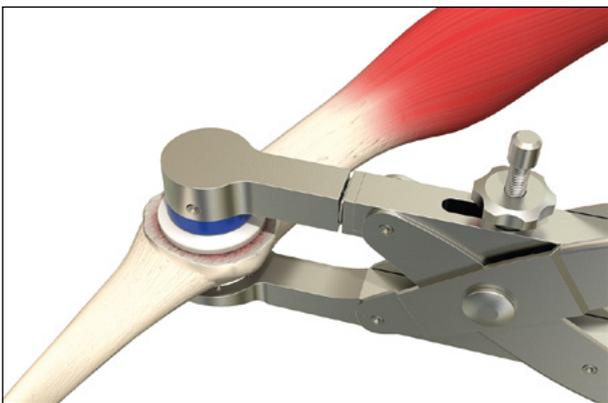


Fig. 78

Dopo l'indurimento del cemento, ritirare il morsetto di cementazione.

Dopo la chiusura della capsula articolare, conduzione di un test funzionale conclusivo e controllo dello scorrimento centrato della patella.

Allegato

3 – Codici articolo degli impianti balanSys

Componenti femorali balanSys per CR/UC/RP

Femore balanSys, cementato



N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.15.3401	56 mm	XS sinistra
72.15.3701	58 mm	S sinistra
72.15.4001	60 mm	A sinistra
72.15.4301	64 mm	B sinistra
72.15.4601	68 mm	C sinistra
72.15.4901	72 mm	D sinistra
72.15.5201	76 mm	E sinistra
72.15.5501	80 mm	F sinistra
72.15.3402	56 mm	XS destra
72.15.3702	58 mm	S destra
72.15.4002	60 mm	A destra
72.15.4302	64 mm	B destra
72.15.4602	68 mm	C destra
72.15.4902	72 mm	D destra
72.15.5202	76 mm	E destra
72.15.5502	80 mm	F destra

Materiale: CoCrMo

Femore balanSys, non cementato



N° d'art.	Mediolat.	Misura
73.15.3401TPS	56 mm	XS sinistra
73.15.3701TPS	58 mm	S sinistra
73.15.4001TPS	60 mm	A sinistra
73.15.4301TPS	64 mm	B sinistra
73.15.4601TPS	68 mm	C sinistra
73.15.4901TPS	72 mm	D sinistra
73.15.5201TPS	76 mm	E sinistra
73.15.5501TPS	80 mm	F sinistra
73.15.3402TPS	56 mm	XS destra
73.15.3702TPS	58 mm	S destra
73.15.4002TPS	60 mm	A destra
73.15.4302TPS	64 mm	B destra
73.15.4602TPS	68 mm	C destra
73.15.4902TPS	72 mm	D destra
73.15.5202TPS	76 mm	E destra
73.15.5502TPS	80 mm	F destra

Materiale: CoCrMo, rivestito in TiCP

Componenti balanSys Fixed Bearing

Inserto PE balanSys CR



N° d'art.	Mediolat.	Misura	N° d'art.	Mediolat.	Misura
74.30.5908	59mm	8,0mm	74.30.7008	70mm	8,0mm
74.30.5910	59mm	10,5mm	74.30.7010	70mm	10,5mm
74.30.5913	59mm	13,0mm	74.30.7013	70mm	13,0mm
74.30.5915	59mm	15,5mm	74.30.7015	70mm	15,5mm
74.30.6208	62mm	8,0mm	74.30.7508	75mm	8,0mm
74.30.6210	62mm	10,5mm	74.30.7510	75mm	10,5mm
74.30.6213	62mm	13,0mm	74.30.7513	75mm	13,0mm
74.30.6215	62mm	15,5mm	74.30.7515	75mm	15,5mm
74.30.6408	64mm	8,0mm	72.34.0170	80mm	8,0mm
74.30.6410	64mm	10,5mm	72.34.0171	80mm	10,5mm
74.30.6413	64mm	13,0mm	72.34.0172	80mm	13,0mm
74.30.6415	64mm	15,5mm	72.34.0173	80mm	15,5mm
74.30.6708	67mm	8,0mm	72.34.0174	85mm	8,0mm
74.30.6710	67mm	10,5mm	72.34.0175	85mm	10,5mm
74.30.6713	67mm	13,0mm	72.34.0176	85mm	13,0mm
74.30.6715	67mm	15,5mm	72.34.0177	85mm	15,5mm

Materiale: UHMWPE



vitamys®

Inserto vitamys balanSys CR

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1000	59mm	8,0mm
72.34.1001	59mm	9,0mm
72.34.1002	59mm	10,5mm
72.34.1003	59mm	11,5mm
72.34.1004	59mm	13,0mm
72.34.1005	59mm	15,5mm
72.34.1010	62mm	8,0mm
72.34.1011	62mm	9,0mm
72.34.1012	62mm	10,5mm
72.34.1013	62mm	11,5mm
72.34.1014	62mm	13,0mm
72.34.1015	62mm	15,5mm
72.34.1020	64mm	8,0mm
72.34.1021	64mm	9,0mm
72.34.1022	64mm	10,5mm
72.34.1023	64mm	11,5mm
72.34.1024	64mm	13,0mm
72.34.1025	64mm	15,5mm
72.34.1030	67mm	8,0mm
72.34.1031	67mm	9,0mm
72.34.1032	67mm	10,5mm
72.34.1033	67mm	11,5mm
72.34.1034	67mm	13,0mm
72.34.1035	67mm	15,5mm

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1040	70mm	8,0mm
72.34.1041	70mm	9,0mm
72.34.1042	70mm	10,5mm
72.34.1043	70mm	11,5mm
72.34.1044	70mm	13,0mm
72.34.1045	70mm	15,5mm
72.34.1050	75mm	8,0mm
72.34.1051	75mm	9,0mm
72.34.1052	75mm	10,5mm
72.34.1053	75mm	11,5mm
72.34.1054	75mm	13,0mm
72.34.1055	75mm	15,5mm
72.34.1060	80mm	8,0mm
72.34.1061	80mm	9,0mm
72.34.1062	80mm	10,5mm
72.34.1063	80mm	11,5mm
72.34.1064	80mm	13,0mm
72.34.1065	80mm	15,5mm
72.34.1070	85mm	8,0mm
72.34.1071	85mm	9,0mm
72.34.1072	85mm	10,5mm
72.34.1073	85mm	11,5mm
72.34.1074	85mm	13,0mm
72.34.1075	85mm	15,5mm

Materiale: VEPE



Inserto PE balanSys UC

N° d'art.	Mediolat.	Misura
77.30.5908	59mm	8,0mm
77.30.5910	59mm	10,5mm
77.30.5913	59mm	13,0mm
77.30.5915	59mm	15,5mm
77.30.5918	59mm	18,0mm
77.30.5920	59mm	20,5mm
77.30.6208	62mm	8,0mm
77.30.6210	62mm	10,5mm
77.30.6213	62mm	13,0mm
77.30.6215	62mm	15,5mm
77.30.6218	62mm	18,0mm
77.30.6220	62mm	20,5mm
77.30.6408	64mm	8,0mm
77.30.6410	64mm	10,5mm
77.30.6413	64mm	13,0mm
77.30.6415	64mm	15,5mm
77.30.6418	64mm	18,0mm
77.30.6420	64mm	20,5mm
77.30.6708	67mm	8,0mm
77.30.6710	67mm	10,5mm
77.30.6713	67mm	13,0mm
77.30.6715	67mm	15,5mm
77.30.6718	67mm	18,0mm
77.30.6720	67mm	20,5mm

N° d'art.	Mediolat.	Misura
77.30.7008	70mm	8,0mm
77.30.7010	70mm	10,5mm
77.30.7013	70mm	13,0mm
77.30.7015	70mm	15,5mm
77.30.7018	70mm	18,0mm
77.30.7020	70mm	20,5mm
77.30.7508	75mm	8,0mm
77.30.7510	75mm	10,5mm
77.30.7513	75mm	13,0mm
77.30.7515	75mm	15,5mm
77.30.7518	75mm	18,0mm
77.30.7520	75mm	20,5mm
72.34.0182	80mm	8,0mm
72.34.0183	80mm	10,5mm
72.34.0184	80mm	13,0mm
72.34.0185	80mm	15,5mm
72.34.0186	80mm	18,0mm
72.34.0187	80mm	20,5mm
72.34.0188	85mm	8,0mm
72.34.0189	85mm	10,5mm
72.34.0190	85mm	13,0mm
72.34.0191	85mm	15,5mm
72.34.0192	85mm	18,0mm
72.34.0193	85mm	20,5mm

Materiale: UHMWPE



vitamys®

Inserto vitamys balanSys UC

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1100	59mm	8,0mm
72.34.1101	59mm	9,0mm
72.34.1102	59mm	10,5mm
72.34.1103	59mm	11,5mm
72.34.1104	59mm	13,0mm
72.34.1105	59mm	15,5mm
72.34.1106	59mm	18,0mm
72.34.1107*	59mm	20,5mm
72.34.1110	62mm	8,0mm
72.34.1111	62mm	9,0mm
72.34.1112	62mm	10,5mm
72.34.1113	62mm	11,5mm
72.34.1114	62mm	13,0mm
72.34.1115	62mm	15,5mm
72.34.1116	62mm	18,0mm
72.34.1117*	62mm	20,5mm
72.34.1120	64mm	8,0mm
72.34.1121	64mm	9,0mm
72.34.1122	64mm	10,5mm
72.34.1123	64mm	11,5mm
72.34.1124	64mm	13,0mm
72.34.1125	64mm	15,5mm
72.34.1126	64mm	18,0mm
72.34.1127*	64mm	20,5mm
72.34.1130	67mm	8,0mm
72.34.1131	67mm	9,0mm
72.34.1132	67mm	10,5mm
72.34.1133	67mm	11,5mm
72.34.1134	67mm	13,0mm
72.34.1135	67mm	15,5mm
72.34.1136	67mm	18,0mm
72.34.1137*	67mm	20,5mm

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1140	70mm	8,0mm
72.34.1141	70mm	9,0mm
72.34.1142	70mm	10,5mm
72.34.1143	70mm	11,5mm
72.34.1144	70mm	13,0mm
72.34.1145	70mm	15,5mm
72.34.1146	70mm	18,0mm
72.34.1147*	70mm	20,5mm
72.34.1150	75mm	8,0mm
72.34.1151	75mm	9,0mm
72.34.1152	75mm	10,5mm
72.34.1153	75mm	11,5mm
72.34.1154	75mm	13,0mm
72.34.1155	75mm	15,5mm
72.34.1156	75mm	18,0mm
72.34.1157*	75mm	20,5mm
72.34.1160	80mm	8,0mm
72.34.1161	80mm	9,0mm
72.34.1162	80mm	10,5mm
72.34.1163	80mm	11,5mm
72.34.1164	80mm	13,0mm
72.34.1165	80mm	15,5mm
72.34.1166	80mm	18,0mm
72.34.1167*	80mm	20,5mm
72.34.1170	85mm	8,0mm
72.34.1171	85mm	9,0mm
72.34.1172	85mm	10,5mm
72.34.1173	85mm	11,5mm
72.34.1174	85mm	13,0mm
72.34.1175	85mm	15,5mm
72.34.1176	85mm	18,0mm
72.34.1177*	85mm	20,5mm

Materiale: VEPE

*su richiesta



Piatto tibiale PS balanSys, cementato

N° d'art.	Mediolaterale
79.15.0400	59 mm
79.15.0401	62 mm
79.15.0056	64 mm
79.15.0402	67 mm
79.15.0057	70 mm
79.15.0058	75 mm
79.15.0059	80 mm
79.15.0060	85 mm

Materiale: CoCrMo

Componenti balanSys Mobile Bearing RP

Inserto PE balanSys RP



N° d'art.	Femore	Misura	N° d'art.	Femore	Misura
72.34.0200	XS	8,0 mm	78.30.7008	C	8,0 mm
72.34.0201	XS	10,5 mm	78.30.7010	C	10,5 mm
72.34.0202	XS	13,0 mm	78.30.7013	C	13,0 mm
72.34.0203	XS	15,5 mm	78.30.7015	C	15,5 mm
72.34.0206	S	8,0 mm	78.30.7408	D	8,0 mm
72.34.0207	S	10,5 mm	78.30.7410	D	10,5 mm
72.34.0208	S	13,0 mm	78.30.7413	D	13,0 mm
72.34.0209	S	15,5 mm	78.30.7415	D	15,5 mm
78.30.6208	A	8,0 mm	78.30.7808	E	8,0 mm
78.30.6210	A	10,5 mm	78.30.7810	E	10,5 mm
78.30.6213	A	13,0 mm	78.30.7813	E	13,0 mm
78.30.6215	A	15,5 mm	78.30.7815	E	15,5 mm
78.30.6608	B	8,0 mm	72.34.0242	F	8,0 mm
78.30.6610	B	10,5 mm	72.34.0243	F	10,5 mm
78.30.6613	B	13,0 mm	72.34.0244	F	13,0 mm
78.30.6615	B	15,5 mm	72.34.0245	F	15,5 mm

Materiale: UHMWPE, FeCrNiMoMn (sfere a contrasto, facoltative)



vitamys®

Inserto vitamys balanSys RP

N° d'art.	Femore	Misura
72.34.1200	XS	8,0mm
72.34.1201	XS	9,0mm
72.34.1202	XS	10,5mm
72.34.1203	XS	11,5mm
72.34.1204	XS	13,0mm
72.34.1205	XS	15,5mm
72.34.1210	S	8,0mm
72.34.1211	S	9,0mm
72.34.1212	S	10,5mm
72.34.1213	S	11,5mm
72.34.1214	S	13,0mm
72.34.1215	S	15,5mm
72.34.1220	A	8,0mm
72.34.1221	A	9,0mm
72.34.1222	A	10,5mm
72.34.1223	A	11,5mm
72.34.1224	A	13,0mm
72.34.1225	A	15,5mm
72.34.1230	B	8,0mm
72.34.1231	B	9,0mm
72.34.1232	B	10,5mm
72.34.1233	B	11,5mm
72.34.1234	B	13,0mm
72.34.1235	B	15,5mm

Materiale: VEPE

N° d'art.	Femore	Misura
72.34.1240	C	8,0mm
72.34.1241	C	9,0mm
72.34.1242	C	10,5mm
72.34.1243	C	11,5mm
72.34.1244	C	13,0mm
72.34.1245	C	15,5mm
72.34.1250	D	8,0mm
72.34.1251	D	9,0mm
72.34.1252	D	10,5mm
72.34.1253	D	11,5mm
72.34.1254	D	13,0mm
72.34.1255	D	15,5mm
72.34.1260	E	8,0mm
72.34.1261	E	9,0mm
72.34.1262	E	10,5mm
72.34.1263	E	11,5mm
72.34.1264	E	13,0mm
72.34.1265	E	15,5mm
72.34.1270	F	8,0mm
72.34.1271	F	9,0mm
72.34.1272	F	10,5mm
72.34.1273	F	11,5mm
72.34.1274	F	13,0mm
72.34.1275	F	15,5mm

Piatto tibiale balanSys RP, cementato



N° d'art.	Mediolaterale
72.34.0059	59mm
72.34.0060	62mm
72.34.0061	64mm
72.34.0062	67mm
72.34.0063	70mm
72.34.0064	75mm
72.34.0065	80mm
72.34.0066	85mm

Materiale: CoCrMo

Componenti balanSys PS

Femore balanSys PS, cementato



N° d'art.	Mediolat.	Misura
79.15.0999	56 mm	XS destra
79.15.1000	58 mm	S destra
79.15.0001	60 mm	A destra
79.15.0002	64 mm	B destra
79.15.0003	68 mm	C destra
79.15.0004	72 mm	D destra
79.15.0005	76 mm	E destra
79.15.1006	80 mm	F destra
79.15.1009	56 mm	XS sinistra
79.15.1010	58 mm	S sinistra
79.15.0011	60 mm	A sinistra
79.15.0012	64 mm	B sinistra
79.15.0013	68 mm	C sinistra
79.15.0014	72 mm	D sinistra
79.15.0015	76 mm	E sinistra
79.15.1016	80 mm	F sinistra

Materiale: CoCrMo



Inserto PE balanSys PS

N° d'art.	Mediolat.	Misura
79.30.9986	59mm	8,0mm
79.30.9987	59mm	10,5mm
79.30.9988	59mm	13,0mm
79.30.9989	59mm	15,5mm
79.30.9990	59mm	18,0mm
79.30.9991	59mm	20,5mm
79.30.9992	59mm	23,0mm
79.30.9993	62mm	8,0mm
79.30.9994	62mm	10,5mm
79.30.9995	62mm	13,0mm
79.30.9996	62mm	15,5mm
79.30.9997	62mm	18,0mm
79.30.9998	62mm	20,5mm
79.30.9999	62mm	23,0mm
79.30.0200	64mm	8,0mm
79.30.0201	64mm	10,5mm
79.30.0202	64mm	13,0mm
79.30.0203	64mm	15,5mm
79.30.0204	64mm	18,0mm
79.30.0205	64mm	20,5mm
79.30.0206	64mm	23,0mm
79.30.0210	67mm	8,0mm
79.30.0211	67mm	10,5mm
79.30.0212	67mm	13,0mm
79.30.0213	67mm	15,5mm
79.30.0214	67mm	18,0mm
79.30.0215	67mm	20,5mm
79.30.0216	67mm	23,0mm

Materiale: UHMWPE

N° d'art.	Mediolat.	Misura
79.30.0010	70mm	8,0mm
79.30.0011	70mm	10,5mm
79.30.0012	70mm	13,0mm
79.30.0013	70mm	15,5mm
79.30.0014	70mm	18,0mm
79.30.0015	70mm	20,5mm
79.30.0016	70mm	23,0mm
79.30.0020	75mm	8,0mm
79.30.0021	75mm	10,5mm
79.30.0022	75mm	13,0mm
79.30.0023	75mm	15,5mm
79.30.0024	75mm	18,0mm
79.30.0025	75mm	20,5mm
79.30.0026	75mm	23,0mm
72.34.0255	80mm	8,0mm
72.34.0256	80mm	10,5mm
72.34.0257	80mm	13,0mm
72.34.0258	80mm	15,5mm
72.34.0259	80mm	18,0mm
72.34.0260	80mm	20,5mm
72.34.0261	80mm	23,0mm
72.34.0262	85mm	8,0mm
72.34.0263	85mm	10,5mm
72.34.0264	85mm	13,0mm
72.34.0265	85mm	15,5mm
72.34.0266	85mm	18,0mm
72.34.0267	85mm	20,5mm
72.34.0268	85mm	23,0mm



vitamys®

Inserto vitamys balanSys PS

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1300	59mm	8,0mm
72.34.1301	59mm	9,0mm
72.34.1302	59mm	10,5mm
72.34.1303	59mm	11,5mm
72.34.1304	59mm	13,0mm
72.34.1305	59mm	15,5mm
72.34.1306	59mm	18,0mm
72.34.1307*	59mm	20,5mm
72.34.1310	62mm	8,0mm
72.34.1311	62mm	9,0mm
72.34.1312	62mm	10,5mm
72.34.1313	62mm	11,5mm
72.34.1314	62mm	13,0mm
72.34.1315	62mm	15,5mm
72.34.1316	62mm	18,0mm
72.34.1317*	62mm	20,5mm
72.34.1320	64mm	8,0mm
72.34.1321	64mm	9,0mm
72.34.1322	64mm	10,5mm
72.34.1323	64mm	11,5mm
72.34.1324	64mm	13,0mm
72.34.1325	64mm	15,5mm
72.34.1326	64mm	18,0mm
72.34.1327*	64mm	20,5mm
72.34.1330	67mm	8,0mm
72.34.1331	67mm	9,0mm
72.34.1332	67mm	10,5mm
72.34.1333	67mm	11,5mm
72.34.1334	67mm	13,0mm
72.34.1335	67mm	15,5mm
72.34.1336	67mm	18,0mm
72.34.1337*	67mm	20,5mm

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.34.1340	70mm	8,0mm
72.34.1341	70mm	9,0mm
72.34.1342	70mm	10,5mm
72.34.1343	70mm	11,5mm
72.34.1344	70mm	13,0mm
72.34.1345	70mm	15,5mm
72.34.1346	70mm	18,0mm
72.34.1347*	70mm	20,5mm
72.34.1350	75mm	8,0mm
72.34.1351	75mm	9,0mm
72.34.1352	75mm	10,5mm
72.34.1353	75mm	11,5mm
72.34.1354	75mm	13,0mm
72.34.1355	75mm	15,5mm
72.34.1356	75mm	18,0mm
72.34.1357*	75mm	20,5mm
72.34.1360	80mm	8,0mm
72.34.1361	80mm	9,0mm
72.34.1362	80mm	10,5mm
72.34.1363	80mm	11,5mm
72.34.1364	80mm	13,0mm
72.34.1365	80mm	15,5mm
72.34.1366	80mm	18,0mm
72.34.1367*	80mm	20,5mm
72.34.1370	85mm	8,0mm
72.34.1371	85mm	9,0mm
72.34.1372	85mm	10,5mm
72.34.1373	85mm	11,5mm
72.34.1374	85mm	13,0mm
72.34.1375	85mm	15,5mm
72.34.1376	85mm	18,0mm
72.34.1377*	85mm	20,5mm

Materiale: VEPE

*su richiesta

Componenti balanSys TiNbN

Femore TiNbN balanSys, cementato



N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.23.3401	56 mm	XS sinistra
72.23.3701	58 mm	S sinistra
72.23.4001	60 mm	A sinistra
72.23.4301	64 mm	B sinistra
72.23.4601	68 mm	C sinistra
72.23.4901	72 mm	D sinistra
72.23.5201	76 mm	E sinistra
72.23.5501	80 mm	F sinistra

N° d'art.	Mediolat.	Misura
72.23.3402	56 mm	XS destra
72.23.3702	58 mm	S destra
72.23.4002	60 mm	A destra
72.23.4302	64 mm	B destra
72.23.4602	68 mm	C destra
72.23.4902	72 mm	D destra
72.23.5202	76 mm	E destra
72.23.5502	80 mm	F destra

Materiale: CoCrMo, rivestito in TiNbN

Piatto tibiale fisso TiNbN balanSys PS, cementato



N° d'art.	Mediolaterale
79.23.0400	59 mm
79.23.0401	62 mm
79.23.0056	64 mm
79.23.0402	67 mm

N° d'art.	Mediolaterale
79.23.0057	70 mm
79.23.0058	75 mm
79.23.0059	80 mm
79.23.0060	85 mm

Materiale: CoCrMo, rivestito in TiNbN

Femore TiNbN balanSys PS, cementato



N° d'art.	Mediolat.	Misura
79.23.1009	56 mm	XS sinistra
79.23.1010	58 mm	S sinistra
79.23.0011	60 mm	A sinistra
79.23.0012	64 mm	B sinistra
79.23.0013	68 mm	C sinistra
79.23.0014	72 mm	D sinistra
79.23.0015	76 mm	E sinistra
79.23.1016	80 mm	F sinistra

N° d'art.	Mediolat.	Misura
79.23.0999	56 mm	XS destra
79.23.1000	58 mm	S destra
79.23.0001	60 mm	A destra
79.23.0002	64 mm	B destra
79.23.0003	68 mm	C destra
79.23.0004	72 mm	D destra
79.23.0005	76 mm	E destra
79.23.1006	80 mm	F destra

Materiale: CoCrMo, rivestito in TiNbN

Componenti rotula con 3 perni PIANA balanSys



N° d'art.	Diametro Ø
72.34.0049	26 mm
72.34.0050	28 mm
72.34.0051	31 mm
72.34.0052	34 mm
72.34.0053	37 mm

Materiale: UHMWPE, FeCrNiMoMn (sfere a contrasto)

Componenti rotula con 3 perni balanSys



N° d'art.	Diametro Ø
72.30.0128	28 mm
72.30.0131	31 mm
72.30.0134	34 mm
72.30.0137	37 mm

Materiale: UHMWPE, FeCrNiMoMn (sfere a contrasto)

Allegato

4 – Compatibilità delle misure degli impianti balanSys

balanSys Fixed Bearing CR e UC

Tibia/Inserto		Femore 							
		XS	S	A	B	C	D	E	F
	59/40	✓	✓						
	62/42	✓	✓	✓					
	64/45		✓	✓	✓				
	67/46			✓	✓				
	70/48			✓	✓	✓			
	75/51				✓	✓	✓		
	80/53					✓	✓	✓	✓
	85/55						✓	✓	✓

balanSys PS

Tibia/Inserto		Femore 							
		XS	S	A	B	C	D	E	F
	59/40	✓	✓						
	62/42	✓	✓	✓					
	64/45		✓	✓	✓				
	67/46			✓	✓				
	70/48			✓	✓	✓			
	75/51				✓	✓	✓		
	80/53					✓	✓	✓	✓
	85/55						✓	✓	✓

balanSys Mobile Bearing RP

Tibia		Femore/Inserto 							
		XS	S	A	B	C	D	E	F
	59/40	✓	✓						
	62/42	✓	✓	✓					
	64/45		✓	✓	✓				
	67/46			✓	✓				
	70/48			✓	✓	✓			
	75/51				✓	✓	✓		
	80/53					✓	✓	✓	✓
	85/55						✓	✓	✓

Allegato

5 – Codici articolo degli strumenti balanSys

Strumenti di base

Set base balanSys 71.34.9000A	53
Set di prova strumentario base balanSys 71.34.9005A	58

Tecnica chirurgica

balanSys LIS 4in1 71.34.9030A	61
-------------------------------	----

Strumenti di prova

Set di prova CR/UC balanSys	63
Set di prova PS balanSys	68
Set di prova RP balanSys (opzionale)	74


Strumenti rotulei

Rotula balanSys 3 perni piatto 71.34.0080A	78
Rotula balanSys 3 perni standard 71.34.0081A	78

Prima di ogni intervento, controllare che gli strumenti non siano danneggiati o deformati. Utilizzare soltanto strumenti intatti. Non utilizzare componenti di prova che presentano tracce di usura o graffi.

Set base balanSys 71.34.9000A

Figura assente / 71.34.0545 **Set base balanSys coperchio**

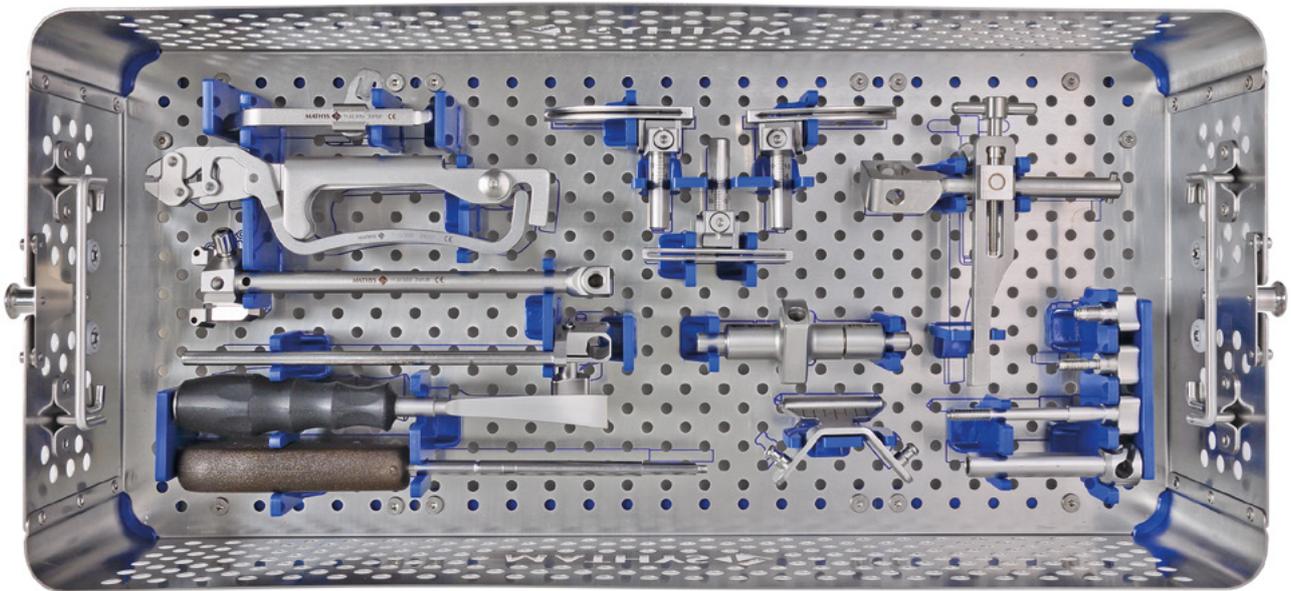

71.34.0546 **Set base balanSys vassoio**



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3096	Palpatore d'altezza tibiale balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3006	Pinza balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3032	Mirino prossimale srt balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3034	Mirino distale srt balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0686	Scalpello curvo p/osteofiti balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
314.270	Cacciavite esag. 3.5	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.4018	Guida p. taglio tibiale srt balanSys 1.3	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3083	Guida p/taglio tib.srt dex.LIS balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3084	balanSys Trs. Tibiaschnittlehre li. LIS	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3043	Guida p/taglio tib.srt sin. LIS balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3035	Forcella srt balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
77.02.0041	Vite di connessione srt balanSys	1


N° d'art.	Descrizione	Qtà
77.02.0019	Vite srt balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
77.02.0043	Vite p/forcella srt balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3036	Porte-forcella srt balanSys	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3041	Manico intramidollare srt balanSys	1

Set base balanSys 71.34.9000A

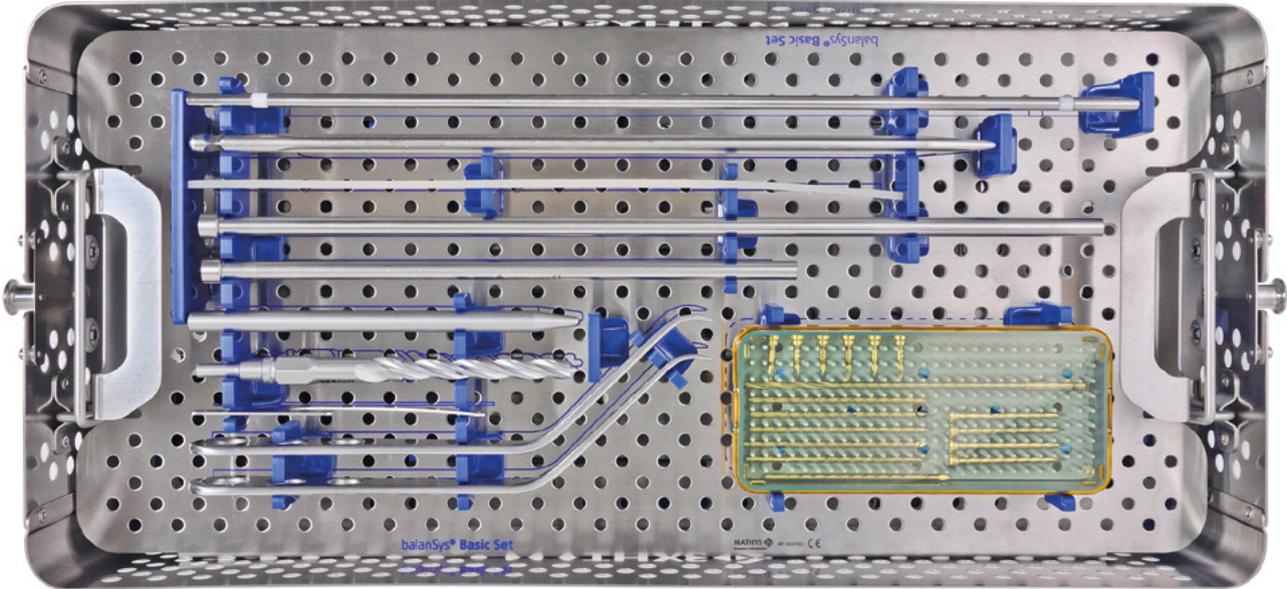

71.34.0547 Set base balanSys ripiano



N° d'art.	Descrizione	Qtà
70.04.0109	Asta di controllo balanSys parte centr.	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3042	Asta intramidollare srt balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.1005	Nastro di gomma srt balanSys 3x25x300	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
70.04.0111	Asta di controllo lunga balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
70.04.0110	Asta di controllo corta balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3014	Asta p/introduzione/estrazione balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3054	Pin balanSys 3.2/80	6



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0108	Pin con testa balanSys 3.2/20	6



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3003	Perno con testa diam. 3,2 mm	4



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0100	balanSys Punta 8.5/11 mm	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
315.310	Punta elicoidale AO, 3.2	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0107	Palpatore 1.3 balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3005	Divaricatore balanSys	2



Strumenti opzionali


N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0647	Pin di foratura 3.2/89/2.25	6



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0787	Raccordo a innesto rapido quadrang. 2.25 (Adattatore per perno di foratura)	1

Set di prova strumentario base balanSys 71.34.9005A

Figura assente / 71.34.0203 **Set di prova cap.no.1 balanSys coperchio**

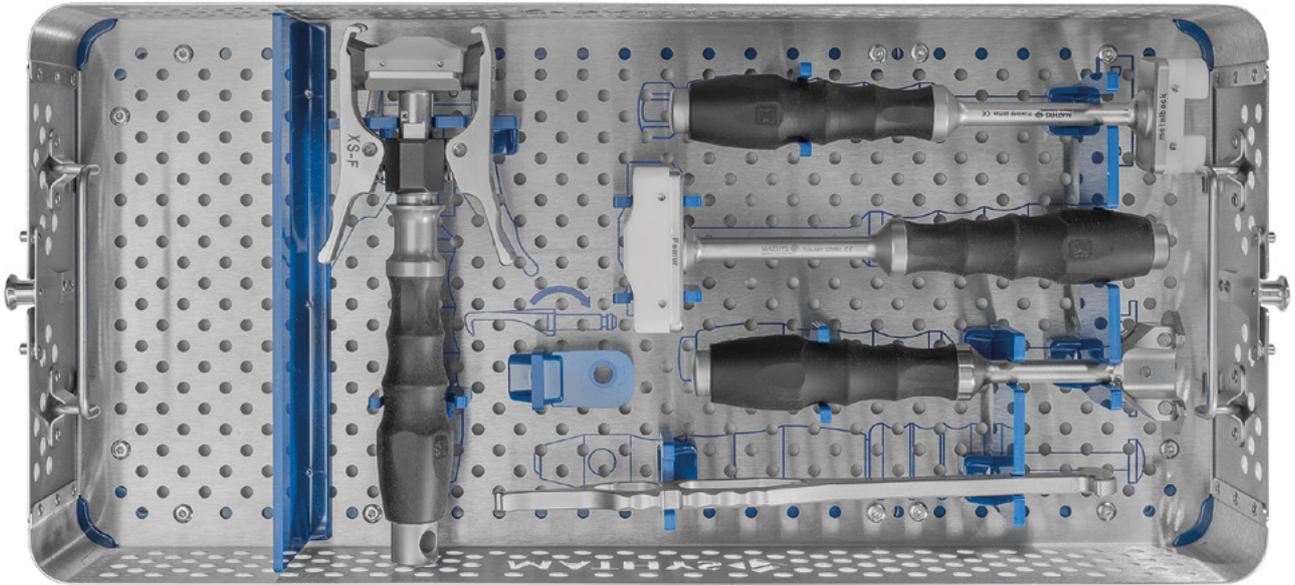

71.34.0204 **Set di prova cap.no.1 balanSys vassoio**



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0744	Ansa Femore balanSys XS-F	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0698	Impattatore tibiale balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0699	Impattatore femorale balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0240	Posizionatore piatto tib balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0788	Estrattore femorale balanSys	1




Strumenti opzionali

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0745	Ansa Femore balanSys XS-D	1

Set di prova strumentario base balanSys 71.34.9005A

Figura assente / 71.34.0205 **Set di prova cap. no.2 balanSys coperchio**

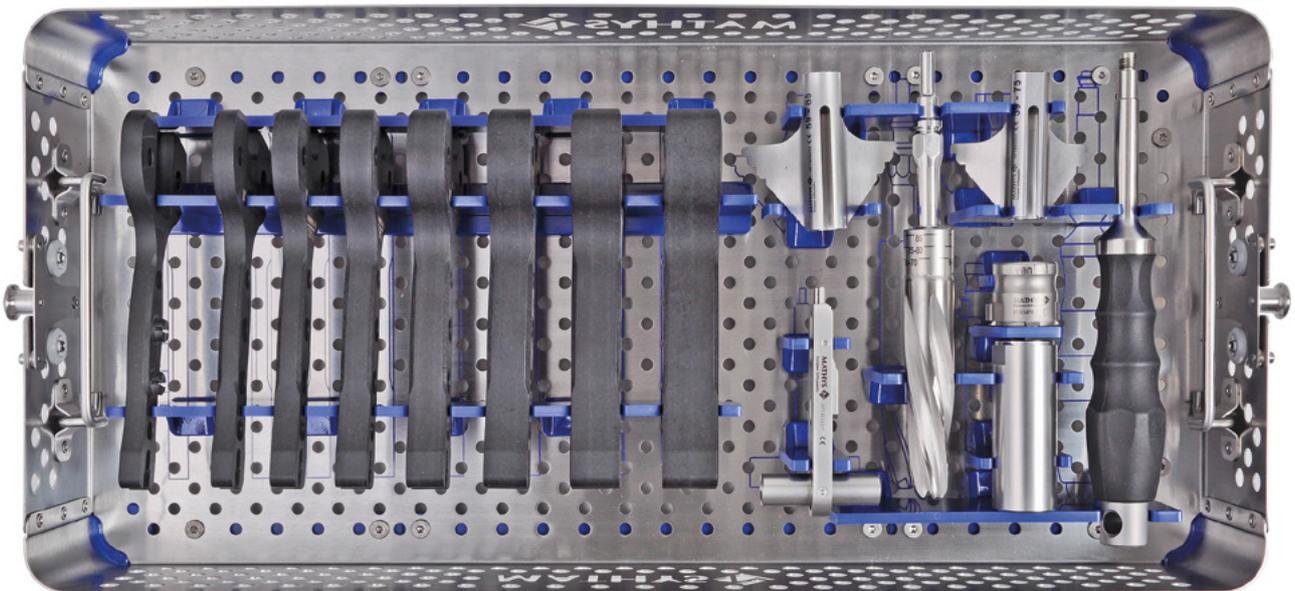

71.34.0206 **Set di prova cap. no.2 balanSys vassoio**



N° d'art.	Descrizione	Qtà
79.02.0651	Blocco distanz. femorale 9 balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
79.02.0640	Blocco distanz. tibiale 8 balanSys	1
71.34.0947*	Blocco distanz. tibiale 9 balanSys	1
79.02.0641	Blocco distanz. tibiale 10.5 balanSys	1
71.34.0948*	Blocco distanz. tibiale 11.5 balanSys	1
79.02.0642	Blocco distanz. tibiale 13 balanSys	1
79.02.0643	Blocco distanz. tibiale 15.5 balanSys	1
79.02.0644	Blocco distanz. tibiale 18 balanSys	1
79.02.0645	Blocco distanz. tibiale 20.5 balanSys	1
79.02.0646	Blocco distanz. tibiale 23 balanSys	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0198	Scalpello per alette balanSys 59–85	1
71.34.0199	Scalpello per alette balanSys 59–75	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0197	Centatura guida scalpello balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0196	Ansa p/calibratore tibiale balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0200	Alesatore flessibile balanSys	1




N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0201	Guida p/alesatore balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0700	Impugnatura p/punzone res. tib. balanSys	1

balanSys LIS 4in1 71.34.9030A

Figura assente / 71.34.0162 **Coperchio balanSys LIS 4in1**

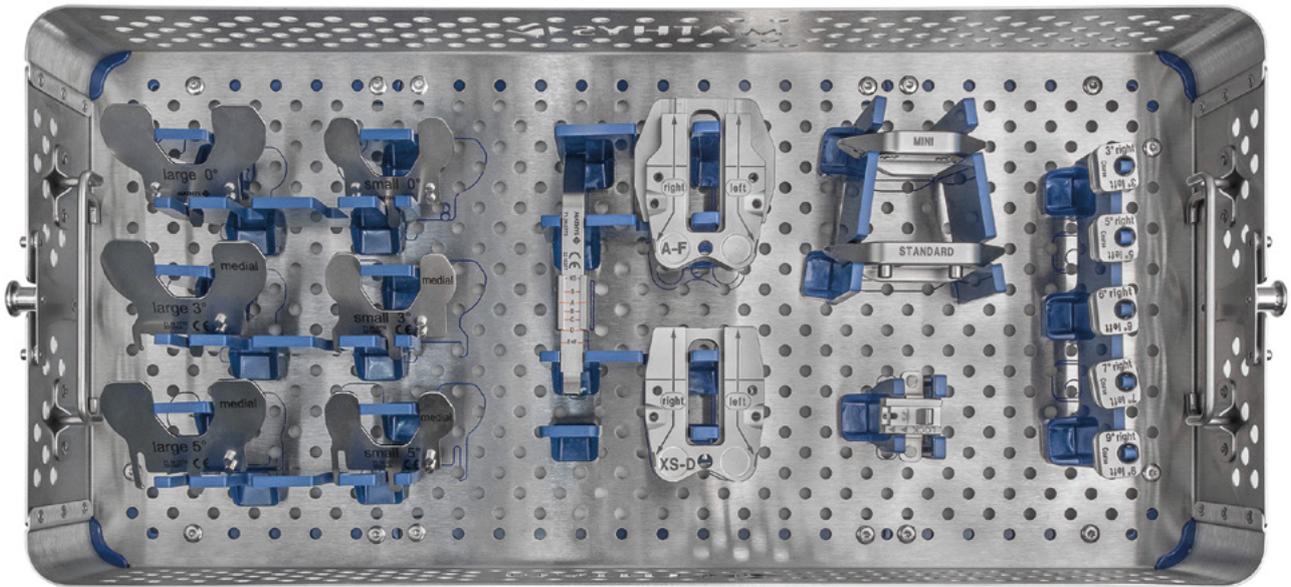

71.34.0163 **Vassoio balanSys LIS 4in1**



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0767	balanSys Comp. Fem./Guida rot. LIS XS-D	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0768	balanSys Comp. Fem./Guida rot. LIS A-F	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0769	balanSys App. rotazione femore Small 0°	1
71.34.0770	balanSys App. rotazione femore Small 3°	1
71.34.0771	balanSys App. rotazione femore Small 5°	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0772	balanSys App. rotazione femore Large 0°	1
71.34.0773	balanSys App. rotazione femore Large 3°	1
71.34.0774	balanSys App. rotazione femore Large 5°	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0775	balanSys Calibro di misura LIS	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0776	balanSys Supp. dist. unità taglio LIS	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3091	Tassello scorr. balanSys 3° sin./dex. LIS	1
71.02.3092	Tassello scorr. balanSys 5° sin./dex. LIS	1
71.34.0777	Tassello scorr. balanSys 6° sin./dex. LIS	1
71.02.3093	Tassello scorr. balanSys 7° sin./dex. LIS	1
71.02.3094	Tassello scorr. balanSys 9° sin./dex. LIS	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0121	Blocco di taglio balanSys dist. STANDARD	1

Strumenti opzionali


NON fanno parte della dotazione standard e devono essere ordinati separatamente:



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0128	Bloc de résec. balanSys distal MINI	1

Set di prova CR/UC no.1 balanSys

Figura assente / 71.34.0241 Set prova CR/UC no.1 balanSys coperchio

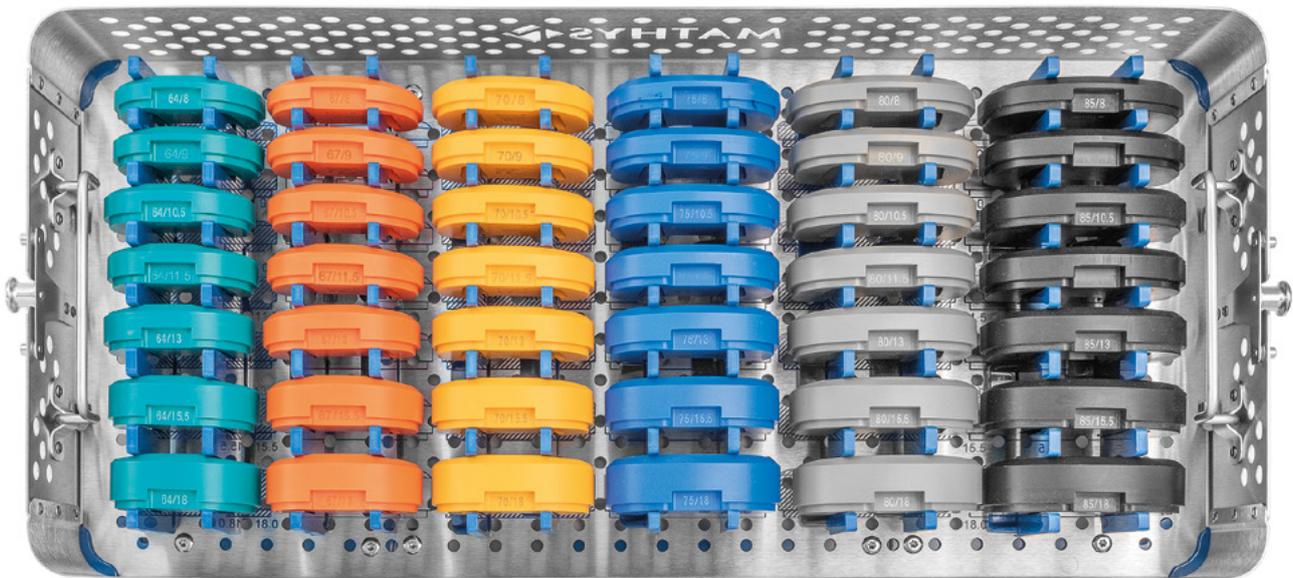

71.34.1075 Vassoio set di prova 7 CR/UC No1 balanSys

balanSys Test Set CR/UC

Configurazioni di misura

Set n.	Femore	Tibia
71.34.9050A	A/B/C/D/E	64/67/70/75/80/85
71.34.0789A	XS/S/F	59/62



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0357	Inserto di prova PE balanSys 59/8	1
71.34.0949*	Inserto di prova PE balanSys 59/9	1
71.34.0358	Inserto di prova PE balanSys 59/10.5	1
71.34.0950*	Inserto di prova PE balanSys 59/11.5	1
71.34.0359	Inserto di prova PE balanSys 59/13	1
71.34.0360	Inserto di prova PE balanSys 59/15.5	1
71.34.0361	Inserto di prova PE balanSys 59/18	1
71.34.0362	Inserto di prova PE balanSys 59/20.5	1
71.34.0210	Inserto di prova PE balanSys 62/8	1
71.34.0951*	Inserto di prova PE balanSys 62/9	1
71.34.0211	Inserto di prova PE balanSys 62/10.5	1
71.34.0952*	Inserto di prova PE balanSys 62/11.5	1
71.34.0212	Inserto di prova PE balanSys 62/13	1
71.34.0213	Inserto di prova PE balanSys 62/15.5	1
71.34.0214	Inserto di prova PE balanSys 62/18	1
71.34.0215	Inserto di prova PE balanSys 62/20.5	1
71.34.0216	Inserto di prova PE balanSys 64/8	1
71.34.0953*	Inserto di prova PE balanSys 64/9	1
71.34.0217	Inserto di prova PE balanSys 64/10.5	1
71.34.0954*	Inserto di prova PE balanSys 64/11.5	1
71.34.0218	Inserto di prova PE balanSys 64/13	1
71.34.0219	Inserto di prova PE balanSys 64/15.5	1
71.34.0220	Inserto di prova PE balanSys 64/18	1
71.34.0221	Inserto di prova PE balanSys 64/20.5	1
71.34.0222	Inserto di prova PE balanSys 67/8	1
71.34.0955*	Inserto di prova PE balanSys 67/9	1
71.34.0223	Inserto di prova PE balanSys 67/10.5	1
71.34.0956*	Inserto di prova PE balanSys 67/11.5	1
71.34.0224	Inserto di prova PE balanSys 67/13	1
71.34.0225	Inserto di prova PE balanSys 67/15.5	1
71.34.0226	Inserto di prova PE balanSys 67/18	1
71.34.0227	Inserto di prova PE balanSys 67/20.5	1
71.34.0477	Inserto di prova PE balanSys 70/8	1
71.34.0957*	Inserto di prova PE balanSys 70/9	1
71.34.0478	Inserto di prova PE balanSys 70/10.5	1
71.34.0958*	Inserto di prova PE balanSys 70/11.5	1
71.34.0479	Inserto di prova PE balanSys 70/13	1
71.34.0480	Inserto di prova PE balanSys 70/15.5	1
71.34.0481	Inserto di prova PE balanSys 70/18	1
71.34.0482	Inserto di prova PE balanSys 70/20.5	1


* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0483	Insero di prova PE balanSys 75/8	1
71.34.0959*	Insero di prova PE balanSys 75/9	1
71.34.0484	Insero di prova PE balanSys 75/10.5	1
71.34.0960*	Insero di prova PE balanSys 75/11.5	1
71.34.0485	Insero di prova PE balanSys 75/13	1
71.34.0486	Insero di prova PE balanSys 75/15.5	1
71.34.0487	Insero di prova PE balanSys 75/18	1
71.34.0488	Insero di prova PE balanSys 75/20.5	1
71.34.0228	Insero di prova PE balanSys 80/8	1
71.34.0961*	Insero di prova PE balanSys 80/9	1
71.34.0229	Insero di prova PE balanSys 80/10.5	1
71.34.0962*	Insero di prova PE balanSys 80/11.5	1
71.34.0230	Insero di prova PE balanSys 80/13	1
71.34.0231	Insero di prova PE balanSys 80/15.5	1
71.34.0232	Insero di prova PE balanSys 80/18	1
71.34.0233	Insero di prova PE balanSys 80/20.5	1
71.34.0234	Insero di prova PE balanSys 85/8	1
71.34.0963*	Insero di prova PE balanSys 85/9	1
71.34.0235	Insero di prova PE balanSys 85/10.5	1
71.34.0964*	Insero di prova PE balanSys 85/11.5	1
71.34.0236	Insero di prova PE balanSys 85/13	1
71.34.0237	Insero di prova PE balanSys 85/15.5	1
71.34.0238	Insero di prova PE balanSys 85/18	1
71.34.0239	Insero di prova PE balanSys 85/20.5	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

Set di prova CR/UC no.2 balanSys

Figura assente / 71.34.0243 Set prova CR/UC no.2 balanSys coperchio

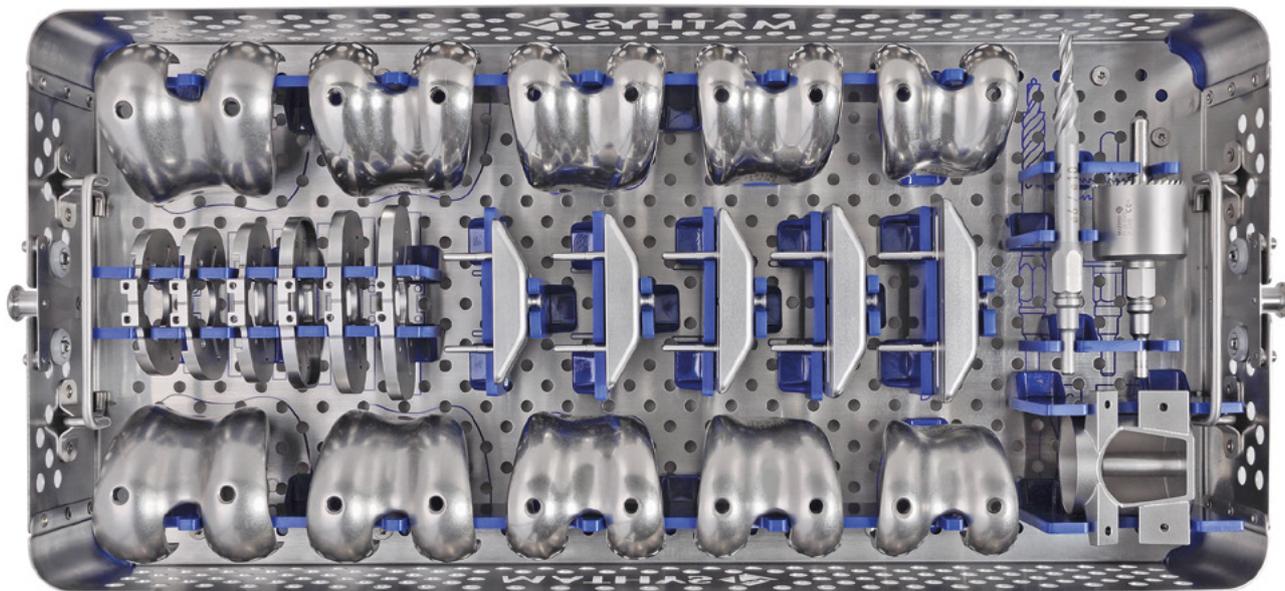

71.34.0244 Set di prova CR/UC no.2 balanSys vassoio



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0355	Femore di prova balanSys XS sin.	1
71.34.0356	Femore di prova balanSys XS dex.	1
71.34.0504	Femore di prova balanSys S sin.	1
71.34.0505	Femore di prova balanSys S dex.	1
71.02.4001	Femore di prova balanSys A sin.	1
71.02.4002	Femore di prova balanSys A dex.	1
71.02.4301	Femore di prova balanSys B sin.	1
71.02.4302	Femore di prova balanSys B dex.	1
71.02.4601	Femore di prova balanSys C sin.	1
71.02.4602	Femore di prova balanSys C dex.	1
71.02.4901	Femore di prova balanSys D sin.	1
71.02.4902	Femore di prova balanSys D dex.	1
71.02.5201	Femore di prova balanSys E sin.	1
71.02.5202	Femore di prova balanSys E dex.	1
71.34.0371	Femore di prova balanSys F sin.	1
71.34.0372	Femore di prova balanSys F dex.	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0353V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD XS	1
71.34.0122V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD S	1
71.34.0123V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD A	1
71.34.0124V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD B	1
71.34.0125V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD C	1
71.34.0126V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD D	1
71.34.0127V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD E	1
71.34.0370V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD F	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0535	Calibratore tibiale CR/PS 59 balanSys	1
71.34.0536	Calibratore tibiale CR/PS 62 balanSys	1
71.34.0537	Calibratore tibiale CR/PS 64 balanSys	1
71.34.0538	Calibratore tibiale CR/PS 67 balanSys	1
71.34.0539	Calibratore tibiale CR/PS 70 balanSys	1
71.34.0540	Calibratore tibiale CR/PS 75 balanSys	1
71.34.0541	Calibratore tibiale CR/PS 80 balanSys	1
71.34.0542	Calibratore tibiale CR/PS 85 balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3023	Fresa trocleare balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.02.3024	Guida per fresa trocleare balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0023	Punta da 6 con arresto balanSys	1

Strumenti opzionali

NON fanno parte della dotazione standard e devono essere ordinati separatamente:



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0363	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI XS	1
71.34.0129	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI S	1
71.34.0130	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI A	1
71.34.0131	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI B	1
71.34.0132	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI C	1
71.34.0133	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI D	1
71.34.0134	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI E	1
71.34.0373	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI F	1




N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0384	Inserto di prova PE balanSys PS 59/8	1
71.34.0965*	Inserto di prova PE balanSys PS 59/9	1
71.34.0385	Inserto di prova PE balanSys PS 59/10.5	1
71.34.0966*	Inserto di prova PE balanSys PS 59/11.5	1
71.34.0386	Inserto di prova PE balanSys PS 59/13	1
71.34.0387	Inserto di prova PE balanSys PS 59/15.5	1
71.34.0388	Inserto di prova PE balanSys PS 59/18	1
71.34.0389	Inserto di prova PE balanSys PS 59/20.5	1
71.34.0503	Inserto di prova PE balanSys PS 59/23	1
71.34.0249	Inserto di prova PE balanSys PS 62/8	1
71.34.0967*	Inserto di prova PE balanSys PS 62/9	1
71.34.0250	Inserto di prova PE balanSys PS 62/10.5	1
71.34.0968*	Inserto di prova PE balanSys PS 62/11.5	1
71.34.0251	Inserto di prova PE balanSys PS 62/13	1
71.34.0252	Inserto di prova PE balanSys PS 62/15.5	1
71.34.0253	Inserto di prova PE balanSys PS 62/18	1
71.34.0254	Inserto di prova PE balanSys PS 62/20.5	1
71.34.0255	Inserto di prova PE balanSys PS 62/23	1
71.34.0256	Inserto di prova PE balanSys PS 64/8	1
71.34.0969*	Inserto di prova PE balanSys PS 64/9	1
71.34.0257	Inserto di prova PE balanSys PS 64/10.5	1
71.34.0970*	Inserto di prova PE balanSys PS 64/11.5	1
71.34.0258	Inserto di prova PE balanSys PS 64/13	1
71.34.0259	Inserto di prova PE balanSys PS 64/15.5	1
71.34.0260	Inserto di prova PE balanSys PS 64/18	1
71.34.0261	Inserto di prova PE balanSys PS 64/20.5	1
71.34.0262	Inserto di prova PE balanSys PS 64/23	1
71.34.0263	Inserto di prova PE balanSys PS 67/8	1
71.34.0971*	Inserto di prova PE balanSys PS 67/9	1
71.34.0264	Inserto di prova PE balanSys PS 67/10.5	1
71.34.0972*	Inserto di prova PE balanSys PS 67/11.5	1
71.34.0265	Inserto di prova PE balanSys PS 67/13	1
71.34.0266	Inserto di prova PE balanSys PS 67/15.5	1
71.34.0267	Inserto di prova PE balanSys PS 67/18	1
71.34.0268	Inserto di prova PE balanSys PS 67/20.5	1
71.34.0269	Inserto di prova PE balanSys PS 67/23	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0489	Insero di prova PE balanSys PS 70/8	1
71.34.0973*	Insero di prova PE balanSys PS 70/9	1
71.34.0490	Insero di prova PE balanSys PS 70/10.5	1
71.34.0974*	Insero di prova PE balanSys PS 70/11.5	1
71.34.0491	Insero di prova PE balanSys PS 70/13	1
71.34.0492	Insero di prova PE balanSys PS 70/15.5	1
71.34.0493	Insero di prova PE balanSys PS 70/18	1
71.34.0494	Insero di prova PE balanSys PS 70/20.5	1
71.34.0495	Insero di prova PE balanSys PS 70/23	1
71.34.0496	Insero di prova PE balanSys PS 75/8	1
71.34.0975*	Insero di prova PE balanSys PS 75/9	1
71.34.0497	Insero di prova PE balanSys PS 75/10.5	1
71.34.0976*	Insero di prova PE balanSys PS 75/11.5	1
71.34.0498	Insero di prova PE balanSys PS 75/13	1
71.34.0499	Insero di prova PE balanSys PS 75/15.5	1
71.34.0500	Insero di prova PE balanSys PS 75/18	1
71.34.0501	Insero di prova PE balanSys PS 75/20.5	1
71.34.0502	Insero di prova PE balanSys PS 75/23	1
71.34.0270	Insero di prova PE balanSys PS 80/8	1
71.34.0977*	Insero di prova PE balanSys PS 80/9	1
71.34.0271	Insero di prova PE balanSys PS 80/10.5	1
71.34.0978*	Insero di prova PE balanSys PS 80/11.5	1
71.34.0272	Insero di prova PE balanSys PS 80/13	1
71.34.0273	Insero di prova PE balanSys PS 80/15.5	1
71.34.0274	Insero di prova PE balanSys PS 80/18	1
71.34.0275	Insero di prova PE balanSys PS 80/20.5	1
71.34.0276	Insero di prova PE balanSys PS 80/23	1
71.34.0277	Insero di prova PE balanSys PS 85/8	1
71.34.0979*	Insero di prova PE balanSys PS 85/9	1
71.34.0278	Insero di prova PE balanSys PS 85/10.5	1
71.34.0980*	Insero di prova PE balanSys PS 85/11.5	1
71.34.0279	Insero di prova PE balanSys PS 85/13	1
71.34.0280	Insero di prova PE balanSys PS 85/15.5	1
71.34.0281	Insero di prova PE balanSys PS 85/18	1
71.34.0282	Insero di prova PE balanSys PS 85/20.5	1
71.34.0283	Insero di prova PE balanSys PS 85/23	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

balanSys Test Set PS

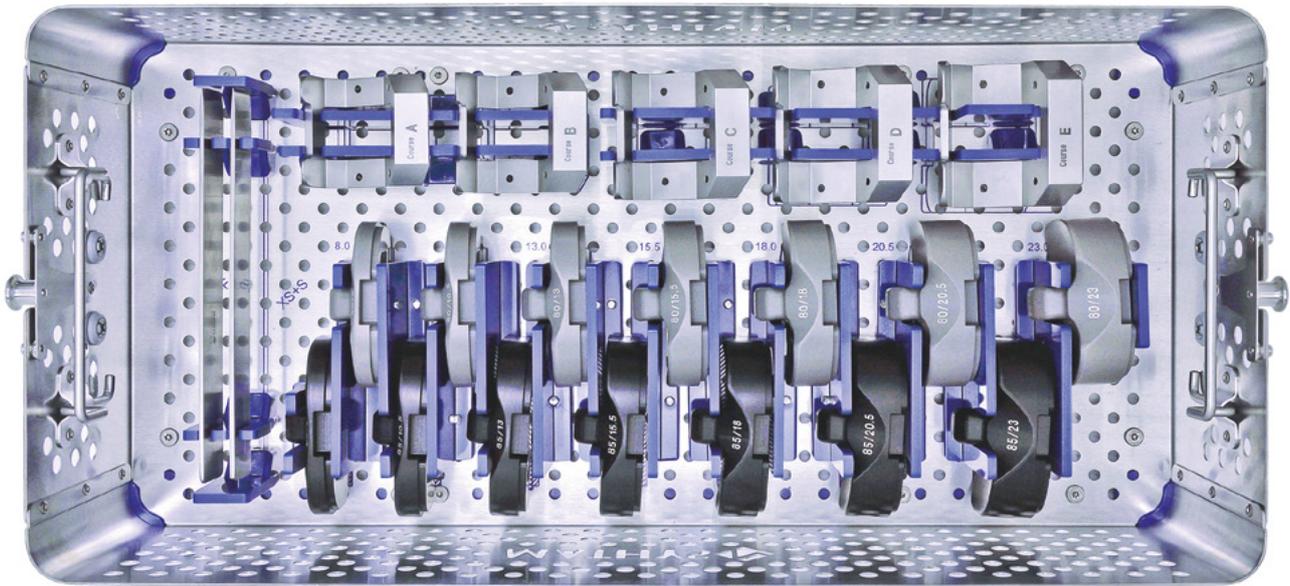

71.34.0287 Vassoio set di prova PS no.1 balanSys



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0690	Scalpello balanSys 22 mm XS/S	1




N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0691	Scalpello balanSys 25 mm A-F	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0390	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS XS	1
71.34.0284	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS S	1
79.02.0265	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS A	1
79.02.0266	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS B	1
79.02.0267	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS C	1
79.02.0268	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS D	1
79.02.0269	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS E	1
71.34.0401	Guida di taglio fem. rett. balanSys PS F	1

Set di prova PS balanSys

Figura assente / 71.34.0289 Coperchio set prova PS no. 2 balanSys

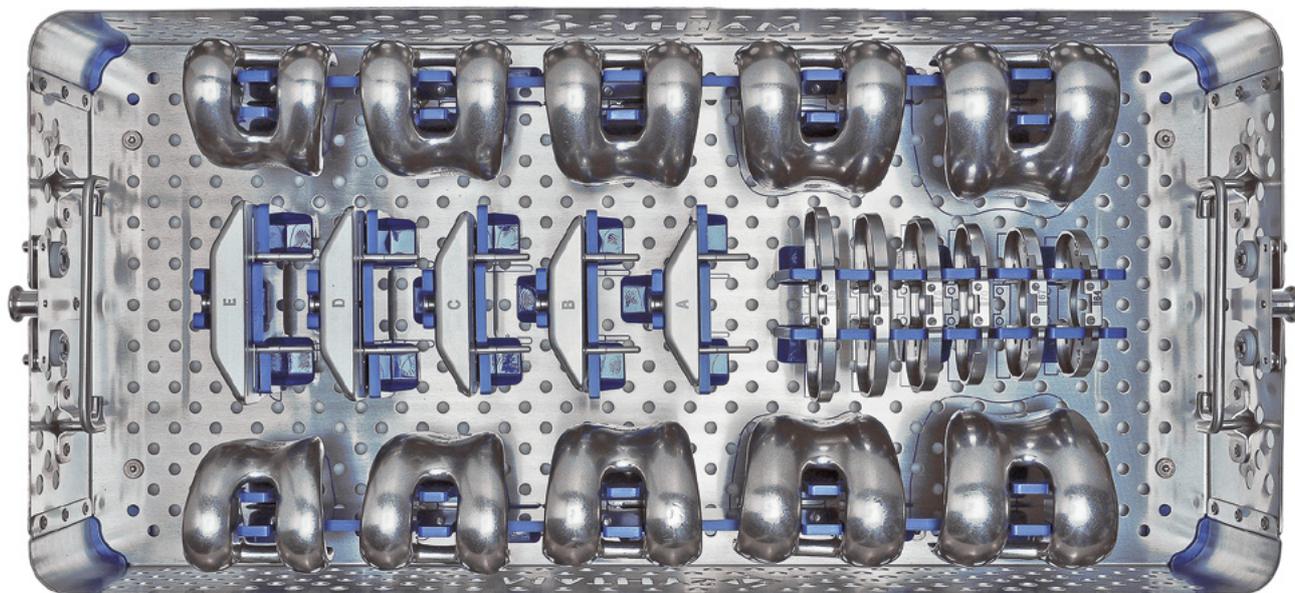

71.34.0290 Vassoio set di prova PS no. 2 balanSys



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0383	Femore di prova balanSys PS XS dex.	1
71.34.0382	Femore di prova balanSys PS XS sin.	1
71.34.0248	Femore di prova balanSys PS S dex.	1
71.34.0247	Femore di prova balanSys PS S sin.	1
79.02.0040	Femore di prova balanSys PS A dex.	1
79.02.0041	Femore di prova balanSys PS A sin.	1
79.02.0042	Femore di prova balanSys PS B dex.	1
79.02.0043	Femore di prova balanSys PS B sin.	1
79.02.0044	Femore di prova balanSys PS C dex.	1
79.02.0045	Femore di prova balanSys PS C sin.	1
79.02.0046	Femore di prova balanSys PS D dex.	1
79.02.0047	Femore di prova balanSys PS D sin.	1
79.02.0048	Femore di prova balanSys PS E dex.	1
79.02.0049	Femore di prova balanSys PS E sin.	1
71.34.0400	Femore di prova balanSys PS F dex.	1
71.34.0399	Femore di prova balanSys PS F sin.	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0353V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD XS	1
71.34.0122V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD S	1
71.34.0123V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD A	1
71.34.0124V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD B	1
71.34.0125V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD C	1
71.34.0126V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD D	1
71.34.0127V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD E	1
71.34.0370V	Blocco taglio balanSys 4in1 STANDARD F	1



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0535	Calibratore tibiale CR/PS 59 balanSys	1
71.34.0536	Calibratore tibiale CR/PS 62 balanSys	1
71.34.0537	Calibratore tibiale CR/PS 64 balanSys	1
71.34.0538	Calibratore tibiale CR/PS 67 balanSys	1
71.34.0539	Calibratore tibiale CR/PS 70 balanSys	1
71.34.0540	Calibratore tibiale CR/PS 75 balanSys	1
71.34.0541	Calibratore tibiale CR/PS 80 balanSys	1
71.34.0542	Calibratore tibiale CR/PS 85 balanSys	1

Strumenti opzionali


NON fanno parte della dotazione standard e devono essere ordinati separatamente:



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0363	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI XS	1
71.34.0129	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI S	1
71.34.0130	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI A	1
71.34.0131	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI B	1
71.34.0132	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI C	1
71.34.0133	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI D	1
71.34.0134	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI E	1
71.34.0373	Blocco di taglio 4in1 balanSys MINI F	1

Set di prova RP balanSys 71.34.9060A (opzionale)

Figura assente / 71.34.1056 **Coperchio set leggera**

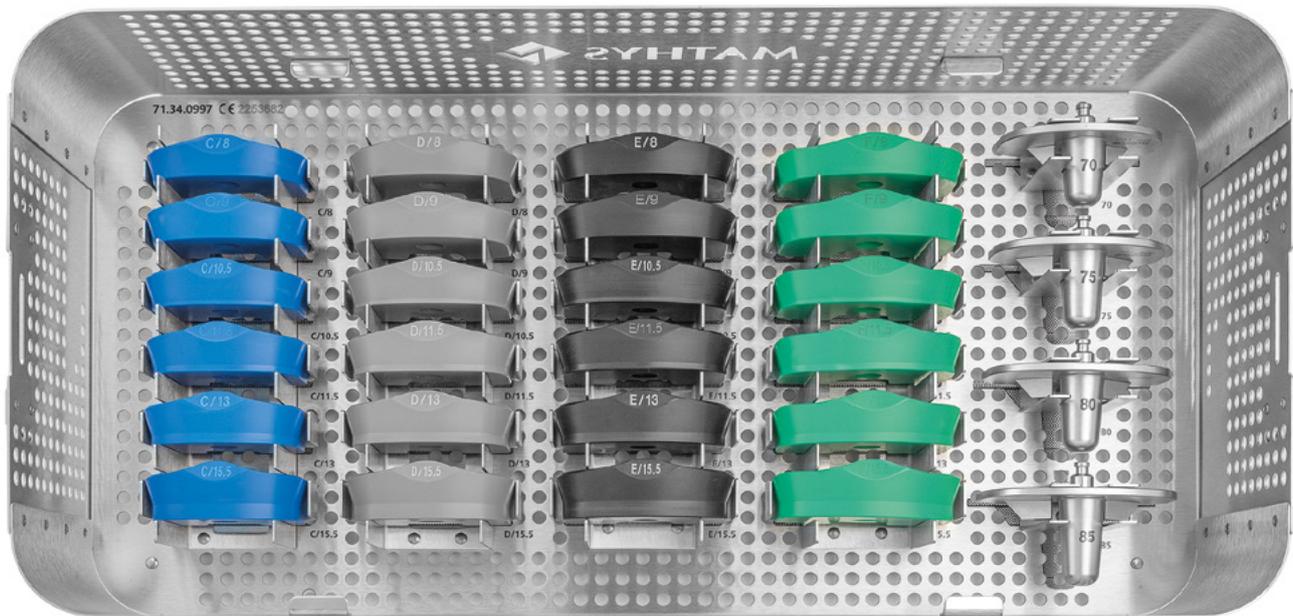

71.34.0997 **Vassoio set di prova 6-RP balanSys**




N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0297	Piatto tibiale di prova 70 balanSys RP	1
71.34.0298	Piatto tibiale di prova 75 balanSys RP	1
71.34.0299	Piatto tibiale di prova 80 balanSys RP	1
71.34.0300	Piatto tibiale di prova 85 balanSys RP	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0574	Inserto di prova PE C/8 balanSys RP	1
71.34.0989*	Inserto di prova PE C/9 balanSys RP	1
71.34.0575	Inserto di prova PE C/10.5 balanSys RP	1
71.34.0990*	Inserto di prova PE C/11.5 balanSys RP	1
71.34.0576	Inserto di prova PE C/13 balanSys RP	1
71.34.0577	Inserto di prova PE C/15.5 balanSys RP	1
71.34.0580	Inserto di prova PE D/8 balanSys RP	1
71.34.0991*	Inserto di prova PE D/9 balanSys RP	1
71.34.0581	Inserto di prova PE D/10.5 balanSys RP	1
71.34.0992*	Inserto di prova PE D/11.5 balanSys RP	1
71.34.0582	Inserto di prova PE D/13 balanSys RP	1
71.34.0583	Inserto di prova PE D/15.5 balanSys RP	1
71.34.0586	Inserto di prova PE E/8 balanSys RP	1
71.34.0993*	Inserto di prova PE E/9 balanSys RP	1
71.34.0587	Inserto di prova PE E/10.5 balanSys RP	1
71.34.0994*	Inserto di prova PE E/11.5 balanSys RP	1
71.34.0588	Inserto di prova PE E/13 balanSys RP	1
71.34.0589	Inserto di prova PE E/15.5 balanSys RP	1
71.34.0429	Inserto di prova PE F/8 balanSys RP	1
71.34.0995*	Inserto di prova PE F/9 balanSys RP	1
71.34.0430	Inserto di prova PE F/10.5 balanSys RP	1
71.34.0996*	Inserto di prova PE F/11.5 balanSys RP	1
71.34.0431	Inserto di prova PE F/13 balanSys RP	1
71.34.0432	Inserto di prova PE F/15.5 balanSys RP	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

Set di prova RP balanSys 71.34.9060A (opzionale)

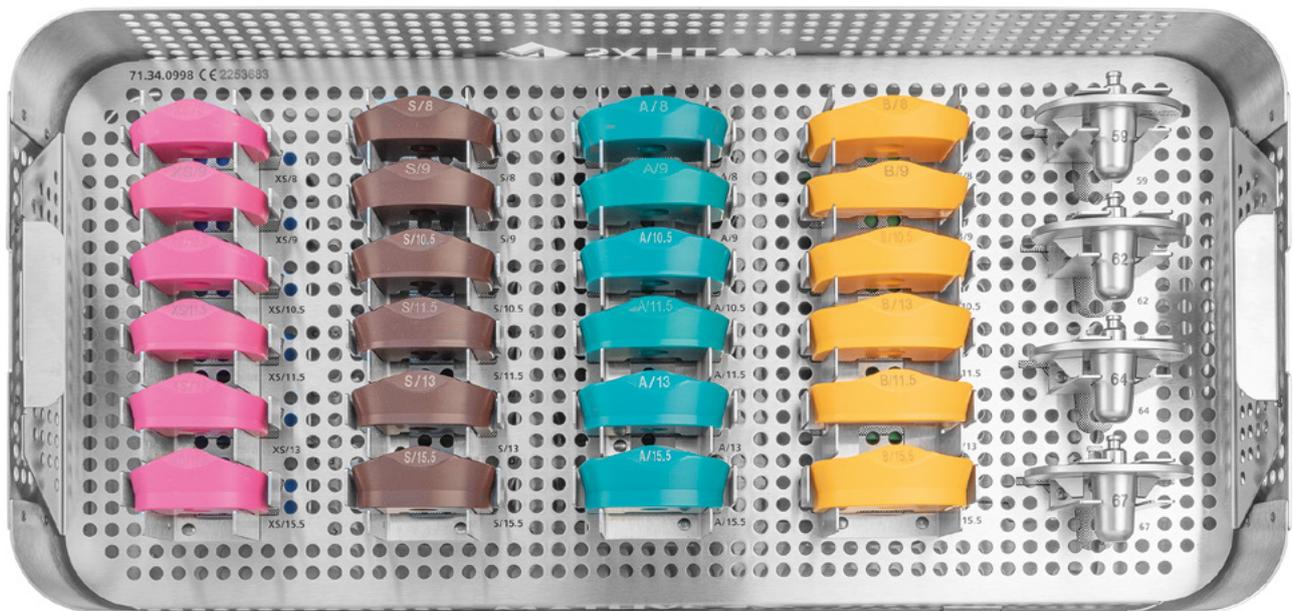

71.34.0998 Ripiano set di prova 6-RP balanSys



N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0418	Piatto tibiale di prova 59 balanSys RP	1
71.34.0294	Piatto tibiale di prova 62 balanSys RP	1
71.34.0295	Piatto tibiale di prova 64 balanSys RP	1
71.34.0296	Piatto tibiale di prova 67 balanSys RP	1

N° d'art.	Descrizione	Qtà
71.34.0413	Inserto di prova PE XS/8 balanSys RP	1
71.34.0981*	Inserto di prova PE XS/9 balanSys RP	1
71.34.0414	Inserto di prova PE XS/10.5 balanSys RP	1
71.34.0982*	Inserto di prova PE XS/11.5 balanSys RP	1
71.34.0415	Inserto di prova PE XS/13 balanSys RP	1
71.34.0416	Inserto di prova PE XS/15.5 balanSys RP	1
71.34.0301	Inserto di prova PE S/8 balanSys RP	1
71.34.0983*	Inserto di prova PE S/9 balanSys RP	1
71.34.0302	Inserto di prova PE S/10.5 balanSys RP	1
71.34.0984*	Inserto di prova PE S/11.5 balanSys RP	1
71.34.0303	Inserto di prova PE S/13 balanSys RP	1
71.34.0304	Inserto di prova PE S/15.5 balanSys RP	1
71.34.0562	Inserto di prova PE A/8 balanSys RP	1
71.34.0985*	Inserto di prova PE A/9 balanSys RP	1
71.34.0563	Inserto di prova PE A/10.5 balanSys RP	1
71.34.0986*	Inserto di prova PE A/11.5 balanSys RP	1
71.34.0564	Inserto di prova PE A/13 balanSys RP	1
71.34.0565	Inserto di prova PE A/15.5 balanSys RP	1
71.34.0568	Inserto di prova PE B/8 balanSys RP	1
71.34.0987*	Inserto di prova PE B/9 balanSys RP	1
71.34.0569	Inserto di prova PE B/10.5 balanSys RP	1
71.34.0988*	Inserto di prova PE B/11.5 balanSys RP	1
71.34.0570	Inserto di prova PE B/13 balanSys RP	1
71.34.0571	Inserto di prova PE B/15.5 balanSys RP	1

* Gli inserti PE balanSys da 9 mm e 11,5 mm sono disponibili soltanto in vitamys.

Rotula balanSys 3 perni piatto 71.34.0080A


Figura assente / 71.34.0082

Coperchio p/rotula balanSys 3 perni piat

Rotula balanSys 3 perni standard 71.34.0081A



Figura assente / 71.34.0084

Coperchio p/rotula balanSys 3 perni std.

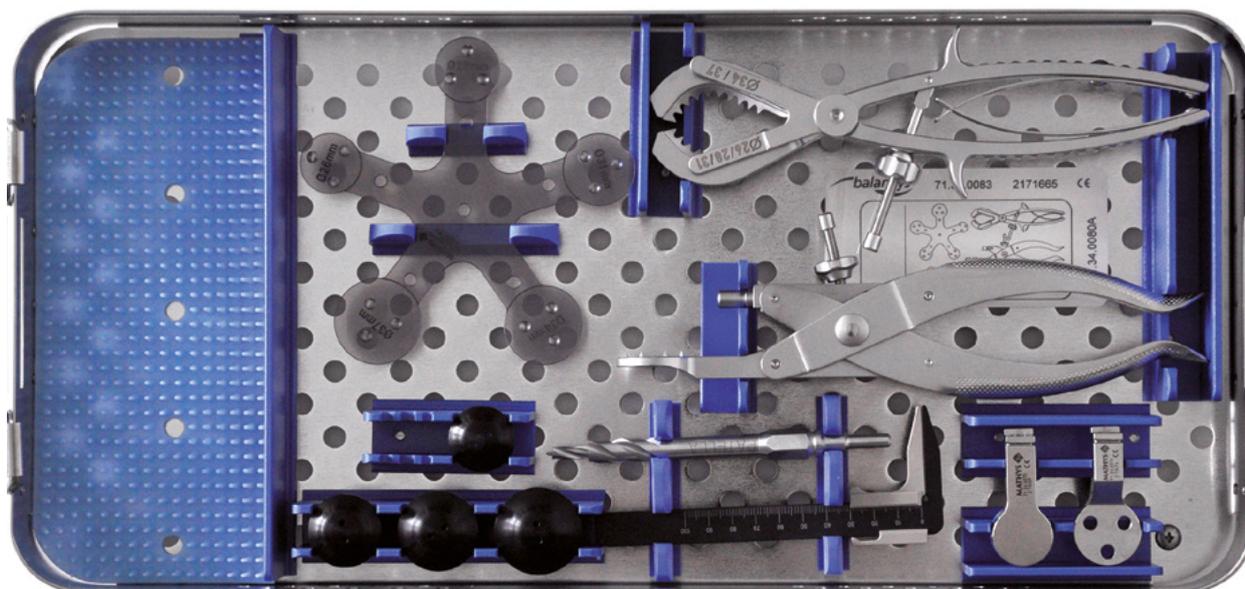

71.34.0083 Vassoio rot. balanSys 3 perni piatto

71.34.0085 Vassoio rot. balanSys 3 perni standard

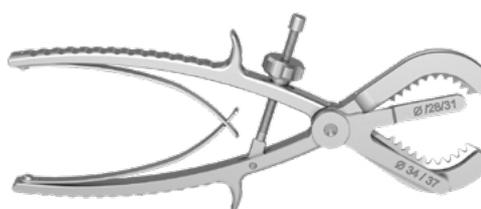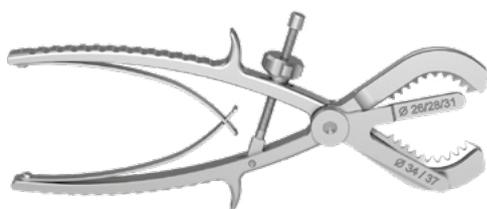

N° d'art.	Descrizione
71.34.0071	Pinza resezione rotula balanSys piatta

N° d'art.	Descrizione
71.34.0070	Pinza resezione rotula balanSys elevata



N° d'art.	Descrizione
71.34.0708	Rotula prova balanSys 3 perni piatto 26
71.34.0075	Rotula prova balanSys 3 perni piatto 28
71.34.0076	Rotula prova balanSys 3 perni piatto 31
71.34.0077	Rotula prova balanSys 3 perni piatto 34
71.34.0078	Rotula prova balanSys 3 perni piatto 37

N° d'art.	Descrizione
71.02.3063	Rotula di prova balanSys 3 perni 28
71.02.3064	Rotula di prova balanSys 3 perni 31
71.02.3065	Rotula di prova balanSys 3 perni 34
71.02.3066	Rotula di prova balanSys 3 perni 37



N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.02.2201	Pinza universale balanSys Patella	1




N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.34.0074	Guida foratura p/pinza rotula balanSys	1



N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.34.0073	Aiuto di cement. p/pinza rotula balanSys	1




N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.02.3061	Punta 5.5	1



Strumenti opzionali

NON fanno parte della dotazione standard e devono essere ordinati separatamente:

N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.34.0079	Calibratore rotuleo balanSys	1

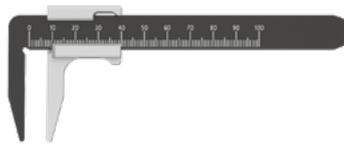


N° d'art.	Descrizione	Qty.
71.02.3002	Calibro a corsoio balanSys Patella	1

Allegato


6 – Codici articolo dei lucidi radiografici balanSys

balanSys BICON Knee System 330.030.034

Adatto per CR, UC e RP

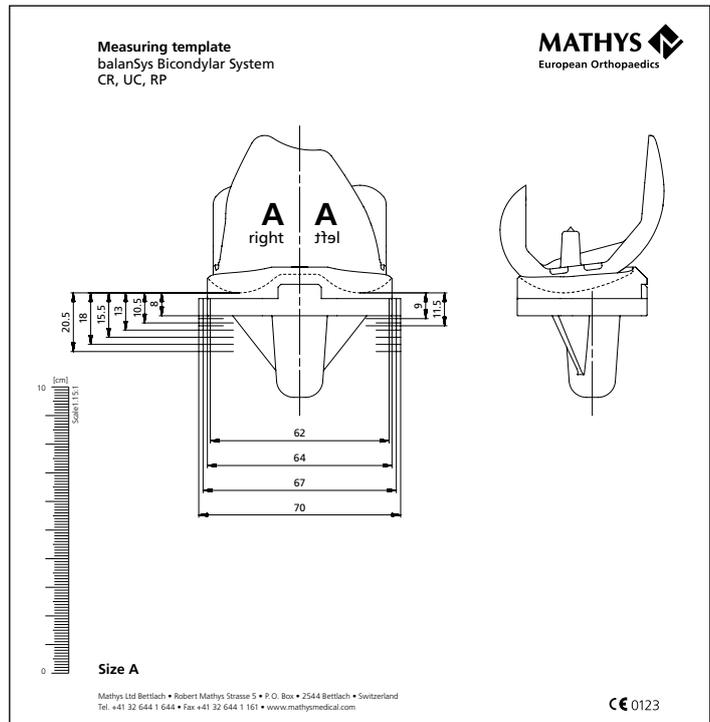

balanSys PS Knee System 330.030.035

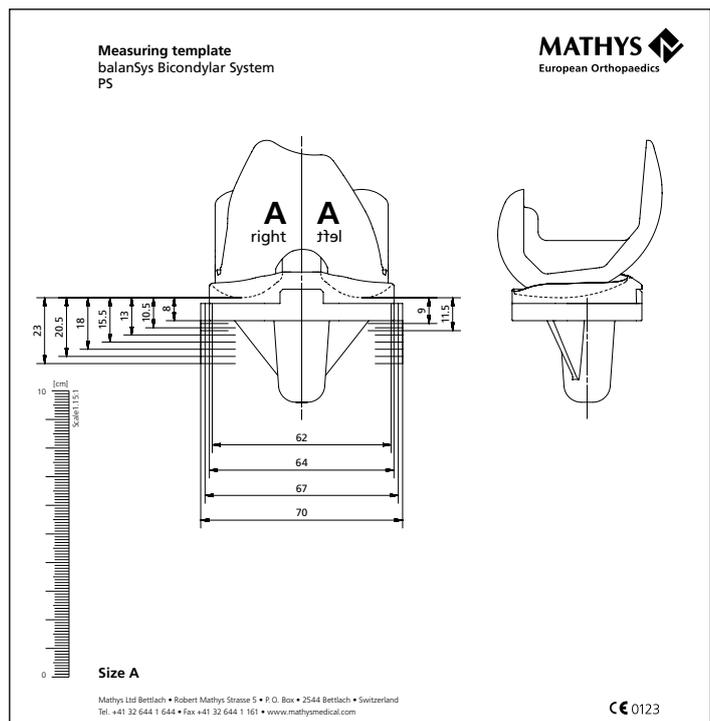

Simboli e abbreviazioni



Fabbricante



Corretto



Non corretto



Attenzione

CR Ritenzione del crociato
(Cruciate Retaining)

UC Ultra congruente
(Ultra Congruent)

PS Stabilizzazione posteriore
(Posterior Stabilized)

RP Piattaforma rotante
(Rotating Platform)

LCA Legamento crociato anteriore

LCP Legamento crociato posteriore

LCM Legamento collaterale mediale

LCL Legamento collaterale laterale

TRS Sistema di riferimento tibiale

IFU Istruzioni per l'uso
(Instruction For Use)

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...